



Mobile Launcher Manual de Usuario

Versión 13.0

7/8/2025

Contenido

1. Mobile Launcher.....	3
1.1 Información para el usuario	3
1.2 Puesta en marcha.....	4
1.2.1 Supervisión de la ejecución de la aplicación	5
1.3 Abrir sesión	5
1.3.1 Iniciar sesión en Android.....	5
1.3.2 Iniciar sesión en iOS.....	7
1.3.3 Iniciar sesión con el código PIN	9
1.3.4 Ascom Myco launcher.....	10
1.3.5 Iniciar sesión con el código BadgePIN	11
1.4 Menú lateral	14
1.5 Barra superior de notificación.....	15
1.6 Notificaciones Sistema General	16
1.7 Procedimiento de Control de Sonido	17
1.8 Funciones de búsqueda de pacientes (Android)	19
1.8.1 Búsqueda textual	20
1.8.2 Búsqueda por lectura de código de barras.....	21
1.8.3 Búsqueda mediante Lector NFC.....	22
1.8.4 Selección de un solo paciente	22
1.9 Funciones de búsqueda de pacientes (iOS).....	24
1.9.1 Búsqueda textual	25
1.9.2 Búsqueda por lectura de código de barras.....	27
1.9.3 Búsqueda mediante Lector NFC	28
1.9.4 Selección de un solo paciente	29
1.10 Funcionalidad de Asignación de Pacientes	31
1.11 Selección/asignación de pacientes, módulos y dominio	33
1.12 Disponibilidad del dispositivo.....	35
1.12.1 Configuración por el usuario	35
1.12.2 Configuración mediante la estación de acoplamiento	36
1.13 Widgets.....	37
1.13.1 Widget de inicio de sesión.....	37
2. Módulo de estadísticas de alarmas.....	40
3. Módulo de indicaciones.....	42

1. Mobile Launcher



Para más información sobre el entorno del producto, precauciones, advertencias y el uso previsto, consúltense los documentos USR ESP Digistat Care y/o USR ESP Digistat Docs (en función de los módulos instalados, para Digistat Suite EU) o USR ENG Digistat Suite NA (para Digistat Suite NA). Es obligatorio conocer y comprender el documento pertinente para un uso correcto y seguro de Mobile Launcher, tal y como se describe en este documento.

Mobile Launcher es el entorno común compartido entre todos los módulos de Digistat Mobile. Digistat Mobile es una aplicación diseñada para poner algunas de las funcionalidades de Digistat Suite directamente «en las manos» de enfermeras y médicos. Mobile Launcher actúa como un contenedor para los módulos de Digistat Mobile. Cada módulo está diseñado para proporcionar información específica y presentarla al personal de manera clara y concisa.

El Mobile Launcher es compatible con Android e iOS. Algunas funcionalidades no están disponibles para iOS. Siempre que esto ocurra, en este manual se incluirá una advertencia específica: "No disponible en iOS". Algunas de las pantallas y flujos de trabajo pueden diferir ligeramente entre los dos sistemas operativos. En estos casos, las diferencias se describen en párrafos separados.

1.1 Información para el usuario

Por favor, lea atentamente los siguientes avisos.



En caso de desconexión de la aplicación Mobile Launcher, se genera una notificación específica, que consiste en un sonido y una vibración característicos y persistentes. La duración del sonido es configurable. El sonido se repite hasta que se restablece la conexión. La conexión se restablece automáticamente lo antes posible. Sólo relevante para Android.



El usuario llevará el dispositivo móvil siempre consigo, ya sea en contacto directo o lo suficientemente cerca como para que sea claramente audible. Sólo relevante para Android.



La aplicación Mobile Launcher puede mostrar información personal y/o confidencial. Por ello, se recomienda no dejar desatendido el dispositivo de mano en el que esté funcionando la aplicación Mobile Launcher o, en su caso, efectuar siempre el registro de salida antes de dejarla desatendido.



El usuario tiene la facultad de cerrar Mobile Launcher. A partir de ese momento, la aplicación no enviará ninguna otra notificación.



Debido a la arquitectura Android, en casos excepcionales, difíciles de predecir, el sistema operativo puede cerrar la aplicación Mobile Launcher. Cuando eso ocurra, la aplicación dejará de enviar notificaciones.



El dispositivo móvil debe admitir el modo vibración. Sólo relevante para Android.



Usar el procedimiento de control de sonido para verificar si el sonido en la estación de trabajo/dispositivo de mano funciona correctamente. Sólo relevante para Android.



Digistat Mobile para iOS no genera notificaciones, incluidas las notificaciones de alarma de Smart Central Mobile. Por lo tanto, no se puede utilizar para responder a tiempo a las alarmas ni para reducir el tiempo de respuesta a las alarmas.

1.2 Puesta en marcha



En la primera ejecución, se solicita al usuario que proporcione algunas autorizaciones básicas y, después, se le redirige automáticamente a la página de Ajustes. Lea los párrafos relacionados en el manual de instalación (*INST ENG Digistat Suite*). Nota: La primera ejecución deberá realizarla personal técnico, autorizado y formado.

Para abrir el Mobile Launcher:

- Tocar el icono .

Se visualiza la siguiente pantalla (Android Fig 1 a – iOS Fig 1 b).

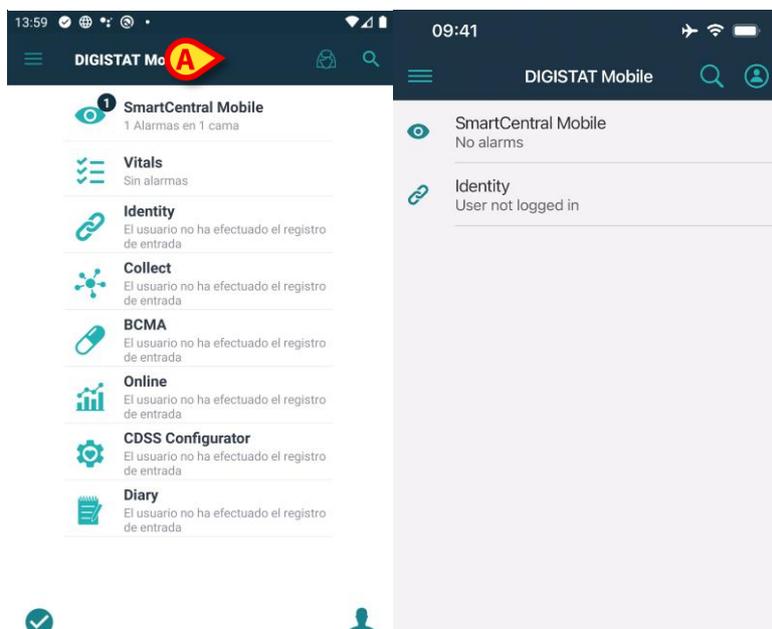


Fig 1 a/b

Los módulos disponibles se indican en la página. Tocar la fila correspondiente al módulo para abrirlo.



Si se produce un error en el servidor para cargar un módulo, este no se abrirá. Aparecerá un mensaje de error "Configuración incorrecta". En ese caso, póngase en contacto con los administradores del sistema".



Si la licencia de un módulo no está disponible, el módulo no se abrirá. En ese caso, se mostrará el mensaje "Licencia no disponible" debajo del nombre del módulo y el botón "Actualizar" a la izquierda. Pulse el botón para intentar cargar de nuevo el módulo (quedará una licencia disponible si se desconecta otro dispositivo). Ver Fig 2 para un ejemplo. El botón de actualización no está disponible en iOS.



Fig 2

1.2.1 Supervisión de la ejecución de la aplicación

En Android, una vez iniciada la aplicación Mobile Launcher, esta se supervisa para garantizar que permanezca en ejecución en todo momento. Si la aplicación se detiene, se reinicia. El reinicio es inmediato y automático, excepto en los casos en que la detención está causada por:

- Procedimiento de configuración. En estos casos, el servicio se reinicia automáticamente cuando finaliza el procedimiento de configuración. Consulte el documento *CFG ENG Digistat Suite* para obtener más información.
- Detención manual. En este caso, el servicio debe reiniciarse manualmente. Consulte el documento *INST ENG Digistat Suite* para obtener más información.

En iOS, si la aplicación pasa a segundo plano, se desconecta automáticamente. Se reconecta automáticamente cuando se vuelve a abrir en primer plano. En este caso, si la opción "Recordarme" no estaba activada en el inicio de sesión anterior, será necesario realizar de nuevo el procedimiento de inicio de sesión (ver sección 1.3.2). En iOS, también se produce una desconexión seguida de una reconexión automática en caso de cierre manual de la aplicación o de cambios en la configuración.

1.3 Abrir sesión

Para acceder a la mayoría de los módulos de Digistat Mobile es necesario que el usuario inicie sesión.

1.3.1 Iniciar sesión en Android

Para iniciar sesión en Mobile Launcher en un dispositivo Android:

- Tocar el **Abrir sesión** icono en el ángulo inferior derecho de la pantalla "Lista de aplicaciones" (Fig 3 A).

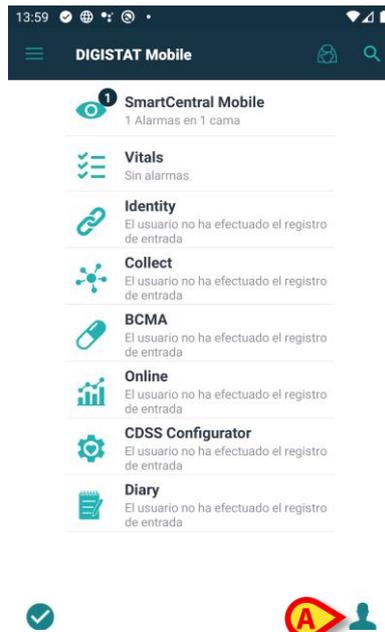


Fig 3

Se visualiza la siguiente pantalla (Fig 3).

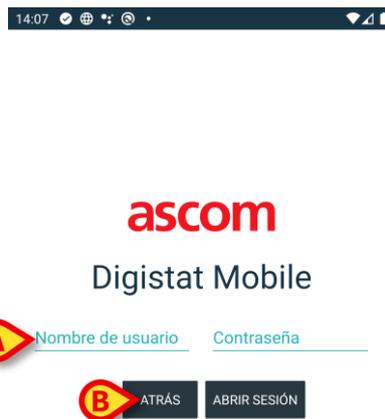


Fig 4

- Introducir nombre de usuario y contraseña (Fig 4 **A**).
- Tocar el botón **Abrir sesión** (Fig 4 **B**).

Acto seguido se muestra una notificación en la que se indica el nombre del usuario que ha iniciado la sesión (Fig 5).

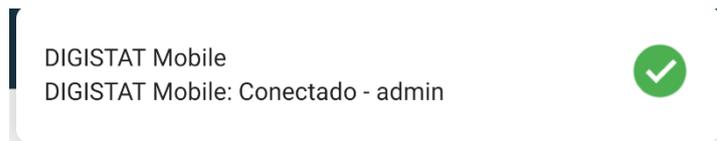


Fig 5

Cuando un usuario ha iniciado sesión, el icono "Login" (Iniciar sesión) cambia como se muestra en la Fig 6 **A**. Tóquelo de nuevo para cerrar la sesión.

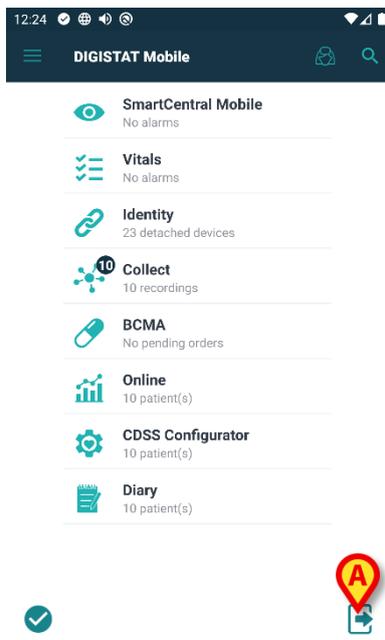


Fig 6



Es posible configurar el producto para permitir el inicio de sesión a través de un sistema externo (single sign on). En estos casos, aparece un botón específico en la pantalla de inicio de sesión.

1.3.2 Iniciar sesión en iOS

Para iniciar sesión en Mobile Launcher en un dispositivo iOS:

- Toque el icono **Login** (Inicio de sesión) en la esquina superior derecha de la página de la lista de módulos (Fig 7 **A**).

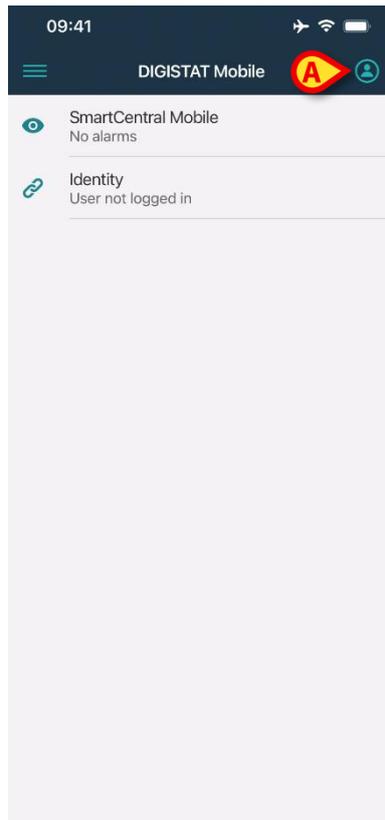


Fig 7

Aparecerá la siguiente pantalla (Fig 8):

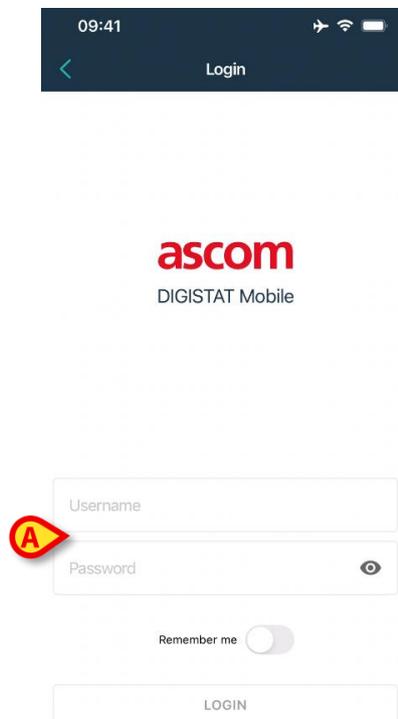


Fig 8

- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña (Fig 8 **A**).

El botón "Login" (Iniciar sesión) se activará automáticamente (Fig 9).

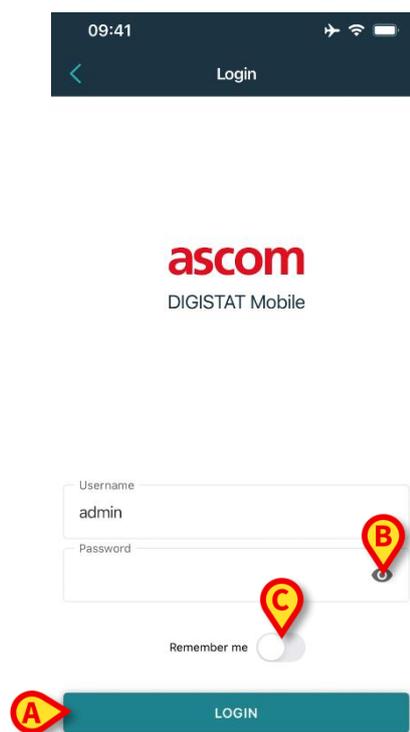


Fig 9

- Toque el botón **Login** (Iniciar sesión) (Fig 9 **A**).

El usuario está así conectado. Cuando un usuario está registrado, el icono "Login" cambia como se muestra en la Fig 10 **A**. Tóquelo de nuevo para cerrar la sesión.



Fig 10

El icono "ojo" (Fig 9 **B**) permite mostrar la contraseña mientras se teclea.

El interruptor "Remember Me" (Recordarme) (Fig 9 **C**) conserva las últimas credenciales utilizadas para el siguiente inicio de sesión.

1.3.3 Iniciar sesión con el código PIN



Este procedimiento se puede realizar solo si el inicio de sesión está gestionado por el Mobile Launcher, es decir, NO con el Myco Launcher.



Funciones no disponibles en iOS.

El «Inicio de sesión con código PIN» es un procedimiento de inicio de sesión más rápido que el habitual. Para ello, el administrador del sistema proporciona al usuario:

- una etiqueta NFC, que activa el procedimiento;

- un código PIN, es decir, un código numérico generado cuando se crea la cuenta de usuario.

Para iniciar sesión a través del código PIN:

- Coloque la etiqueta NFC cerca de la parte posterior del dispositivo móvil.

Se muestra una ventana que permite introducir el código PIN en lugar de la contraseña.

- Pulse el campo de texto «PIN».

Se muestra el teclado numérico que permite la inserción del código PIN:

- Inserte el código PIN y pulse el botón de **abrir sesión**.

Los mensajes específicos alertan al usuario en caso de que:



- Se ha intentado el procedimiento incluso si la aplicación móvil no se está ejecutando;
- El usuario ya está conectado.

1.3.4 Ascom Myco launcher

El Ascom Myco Launcher es una interfaz de usuario opcional para el teléfono SH1 y proporciona funcionalidad para acceder a funciones centrales como la gestión de alertas, la mensajería y el lanzamiento de aplicaciones. El Ascom Myco Launcher puede reemplazar al lanzador estándar de Android, al tiempo que proporciona acceso a la funcionalidad de Android.

El Ascom Myco Launcher solo está disponible en los dispositivos Myco 1 y Myco 2 cuando están integrados con Unite. Requiere la versión 5.1.3 o más reciente de Digistat Mobile.

Digistat Mobile puede ejecutarse en la página más a la derecha cuando se configura para hacerlo.



Fig 11

En este caso, la disposición de la pantalla diferirá ligeramente de la descrita en este manual. Los procedimientos son los mismos.

1.3.5 Iniciar sesión con el código BadgePIN



Este procedimiento se puede realizar solo si el inicio de sesión está gestionado por el Mobile Launcher, es decir, NO con el Myco Launcher.



Funciones no disponibles en iOS.

El procedimiento de inicio de sesión con código BadgePIN es muy similar al del inicio de sesión con código PIN: el usuario debe conectarse realizando las mismas acciones explicadas en el apartado 1.3.3.

Se podrá acceder a la sesión cuando se definan para el usuario los siguientes detalles:

- **BadgeID.** La identificación guardada en el distintivo equipado con NFC suministrado al usuario.
- **BadgePIN.** Un código numérico de al menos 5 dígitos.

La principal diferencia es que, si el establecimiento sanitario lo permite, el mismo usuario puede definir el BadgeID y el BadgePIN. Para más información, consulte el documento *CFG ENG Digistat Suite*.


Si el usuario debe definir el BadgeID y el BadgePIN, en la primera conexión deberá proceder como sigue:

- Inicio de sesión mediante nombre de usuario/contraseña, tal como se explica en el apartado 1.3.

Aparece la siguiente pantalla, lo cual permite al usuario definir su BadgeID escaneando la etiqueta NFC:




- Acerque el dispositivo móvil al distintivo del usuario para escanear la etiqueta NFC. Si la etiqueta NFC del distintivo del usuario se escanea correctamente, aparecerá la siguiente pantalla, lo cual permitirá al usuario definir el BadgePIN:

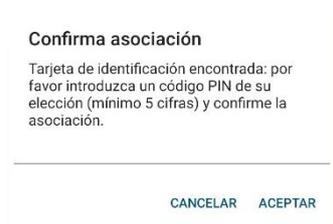

- Configure el BadgePIN como desee. Recuerde que debe ser una secuencia de al menos 5 dígitos.

El procedimiento puede personalizarse para sugerir un BadgePIN aleatorio que puede personalizarse. Para más información, lea el documento *CFG ENG Digistat Suite*. La pantalla anterior será reemplazada por la siguiente:

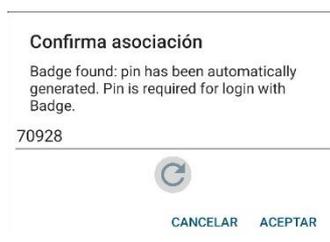

- Pulse el símbolo  para generar un nuevo BadgePIN aleatorio o pulse el BadgePIN para editarlo.

- Pulse el botón **OK** para confirmar.

En el inicio de sesión con código BadgePIN, al usuario se le permite cambiar el BadgeID y el BadgePIN, por ejemplo, si se pierde el distintivo físico. En tal caso, el usuario deberá proceder como sigue:

- Inicio de sesión mediante nombre de usuario/contraseña, tal como se explica en el apartado 1.3.
Se mostrará la página principal del lanzador.

- Pulse el icono  para abrir el menú principal (ver apartado 1.4). Aparecerá la siguiente ventana:

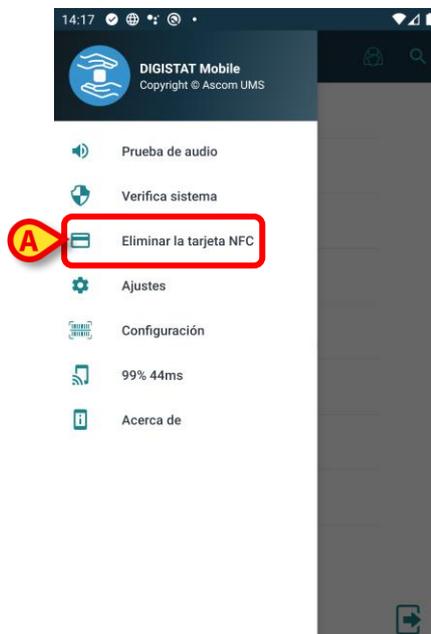


Fig 12

- Pulse el botón **Eliminar la tarjeta NFC** (Fig 12 **A**) para restablecer el BadgeID y el BadgePIN. Se muestra la siguiente pantalla con un cuadro de diálogo donde se solicita confirmación al usuario:

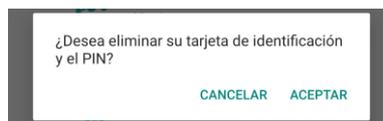


Fig 13

- Pulse el botón **OK** para confirmar. Aparece la siguiente ventana: una notificación del sistema informa al usuario del restablecimiento correcto de las credenciales BadgeID / BadgePIN:
- Repita los pasos explicados anteriormente para asociar un nuevo dúo BadgeID/BadgePIN.

1.4 Menú lateral

El  icono en la página principal abre un menú que contiene una serie de opciones (Android Fig 14 a - iOS Fig 14 b).

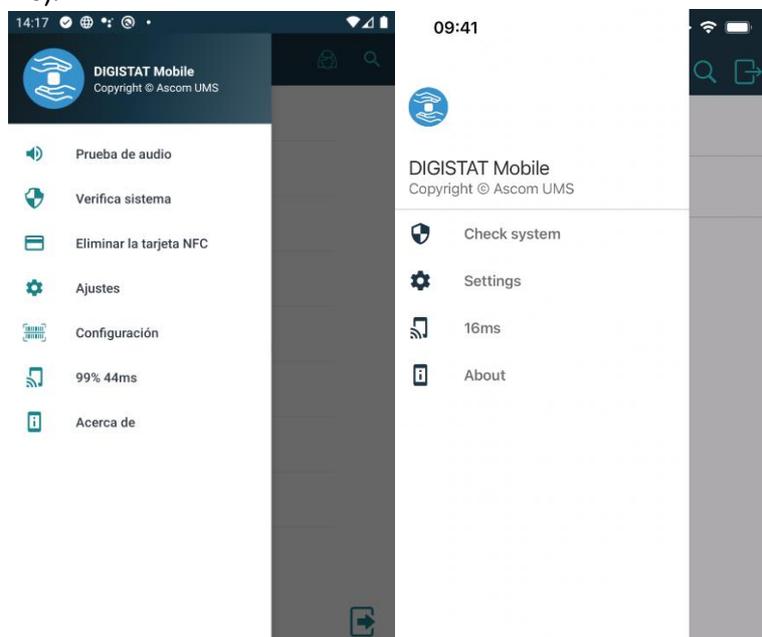


Fig 14 a/b

Los estados son:

Prueba de audio

Tocar el botón de **Prueba de audio** para probar la vibración sonora asociada a las notificaciones. Funciones no disponibles en iOS.

Check system

Toque este elemento para realizar el procedimiento de verificación del sistema (consulte el documento *CFG ENG Digistat Suite*).

Elimine el distintivo (solo disponible en algunas configuraciones de Mobile Launcher)

Pulse este elemento para eliminar un BadgeID registrado y conectarse a través de NFC. Para más información, lea el apartado 1.3.4. Funciones no disponibles en iOS.

Ajustes

Tocar esta opción para acceder a la pantalla de Ajustes (Se requiere una contraseña específica para acceder a la pantalla de Ajustes. Consulte los documentos *CFG ENG Digistat Suite* e *INST ENG Digistat Suite*).

Configuración

Pulse este elemento para acceder a la función de actualización de la configuración a través del código QR (consulte el documento *CFG ENG Digistat Suite*). Funciones no disponibles en iOS.

Estado de la conexión inalámbrica

Indica el estado de la conexión inalámbrica.

Acerca de

Tocar esta opción para abrir una pantalla que contiene información general acerca del Producto y acerca del Fabricante.

1.5 Barra superior de notificación



Funciones no disponibles en iOS.

La barra superior de notificación (Fig 15) siempre está visible y muestra información general. No está disponible cuando se ejecuta en el Myco Launcher.

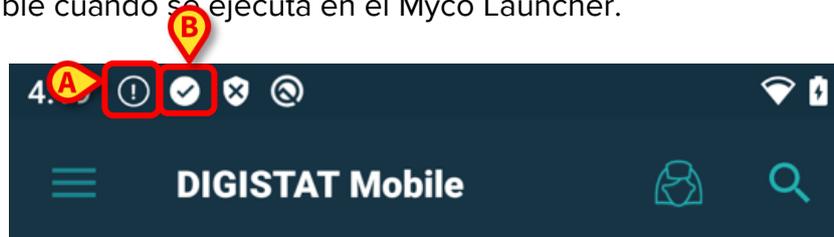


Fig 15

Un icono situado en la esquina superior izquierda (únicamente visible en los dispositivos que no son Myco/UNITE - Fig 15 **A**) se muestra en caso de que se produzcan notificaciones de alarma para al menos uno de los pacientes, procedentes de cualquier módulo. El símbolo que se muestra en la Fig 15 **B** indica que el módulo está activo; de lo contrario, se mostrará un icono de campana  y un icono de círculo tachado  para indicar, respectivamente, que el servicio ha dejado de funcionar y que la aplicación está desconectada.

En la esquina superior derecha se muestra el estado de la conexión Wi-Fi y la información sobre el estado de carga de la batería (Fig 15).

1.6 Notificaciones Sistema General



Funciones no disponibles en iOS.



Digistat Mobile para iOS no genera notificaciones, incluidas las notificaciones de alarma de Smart Central Mobile. Por lo tanto, no se puede utilizar para responder a tiempo a las alarmas ni para reducir el tiempo de respuesta a las alarmas.

Mobile Launcher transmite breves notificaciones de alarmas/mensajes procedentes de cualquier módulo instalado cuando la aplicación no está activa. La notificación de nivel más alto indica el nivel de alarma general de toda la aplicación Mobile Launcher (Fig 16). Existen tres niveles de gravedad para las notificaciones, cada uno de ellos correspondiente a un color diferente (rojo = alta prioridad - amarillo = media prioridad - cian = baja prioridad), además de una notificación puramente informativa que sirve como recordatorio para el usuario (púrpura).

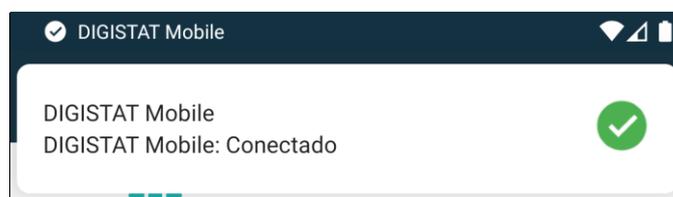


Fig 16

- Desplazar con el dedo la notificación para hacerla desaparecer.

Si la notificación de alarma de un módulo está relacionada con un paciente, al tocarla se muestra la pestaña del paciente con alarma; además, si la notificación de alarma se produce para más de un paciente, al tocarla se muestra la lista de pacientes con alarma.

Según el tipo de dispositivo, las notificaciones procedentes de diferentes aplicaciones de la suite móvil del producto tienen un comportamiento de color de LED diferente

- **Myco 3.** El LED siempre refleja la alarma de mayor prioridad en cualquier momento;
- **Sin - Myco 3.** El LED refleja el último color de notificación.

Esto significa que, en caso de múltiples notificaciones, cuando se pasa la prioridad más alta en un dispositivo Myco3, el color del LED que muestra será el de la siguiente notificación. En dispositivos que no sean Myco3, el LED se desactiva después de un barrido.

Además de las notificaciones en pantalla, el Producto puede gestionar las notificaciones de sonido por medio del altavoz del dispositivo y las notificaciones de luz a través del indicador de notificación.

En el caso de las notificaciones de sonido, el Producto siempre reproduce la notificación con mayor prioridad; si se está ejecutando una notificación y se debe generar una nueva alarma, los Productos reinician la notificación con mayor prioridad. Las notificaciones con nivel de prioridad bajo no tienen ningún sonido asociado.

En caso de parada del servicio, se envía una notificación al usuario: tiene el nivel más alto de severidad y no se puede deslizar.

En caso de desconexión, el Mobile Launcher intenta volver a conectarse al servidor. Si este intento falla, el usuario recibe una notificación del sistema que no se puede deslizar, de acuerdo con las dos opciones siguientes:

- **Versión Android anterior a la versión 8.0.** Una notificación, no deslizable, con nivel de prioridad más alto. El usuario puede silenciarla pulsando el botón de **silencio**;
- **Android 8.0 y versiones posteriores.** Dos notificaciones, una no deslizable sin sonido o color de LED y otra deslizable con el nivel de prioridad más alto, facilitando información útil sobre el motivo de la desconexión. Además, la segunda notificación dejará de visualizarse si el usuario presiona el botón de **silencio**.

1.7 Procedimiento de Control de Sonido



Funciones no disponibles en iOS.



El procedimiento de Control de Sonido se ejecutará al menos una vez por turno.

El procedimiento de Control de Sonido permite verificar si la notificación sonora de la alarma funciona correctamente.

Para ejecutar el procedimiento de "Control de Sonido"

- Activar la pantalla principal de la aplicación Mobile Launcher (Fig 17)

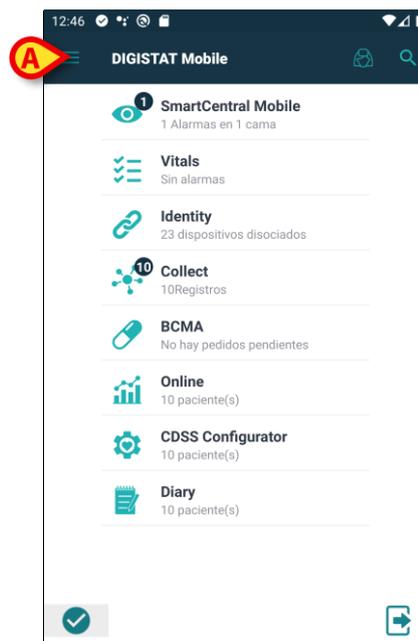


Fig 17

- Tocar el icono  en el ángulo superior izquierdo de la pantalla (Fig 17 **A**)

Se visualiza el siguiente menú (Fig 18).

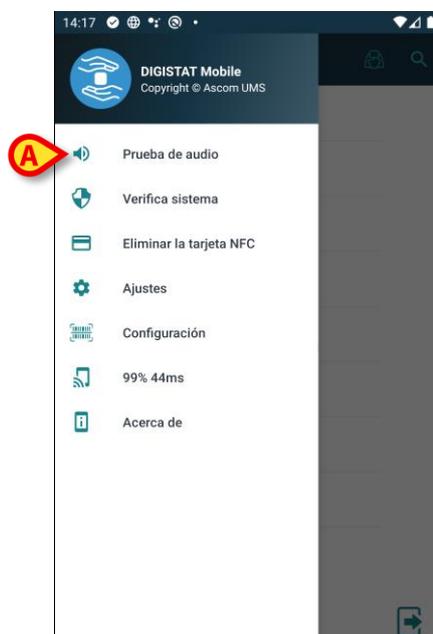


Fig 18

- Tocar la opción **Prueba de audio** (Fig 18 **A**).

Seguirá una notificación/sonido de prueba (Fig 19 **A**).

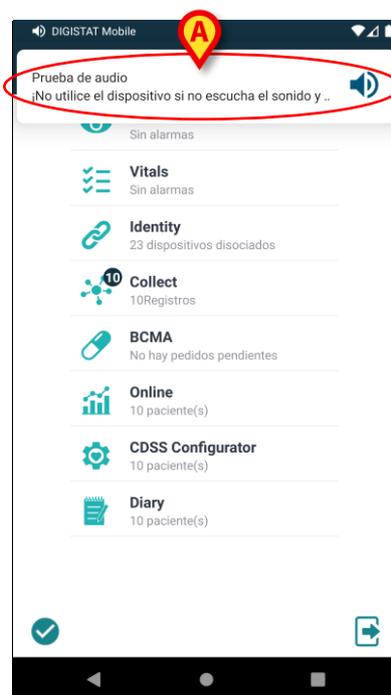


Fig 19



No usar el dispositivo si no se oye el sonido de alarma y/o no se percibe la vibración del dispositivo.

1.8 Funciones de búsqueda de pacientes (Android)

El Producto implementa varias herramientas de búsqueda de pacientes. Se accede a ellas desde la pantalla Lista de Pacientes.

Para acceder a las funcionalidades de búsqueda

- Toque el icono indicado en Fig 20 **A**.

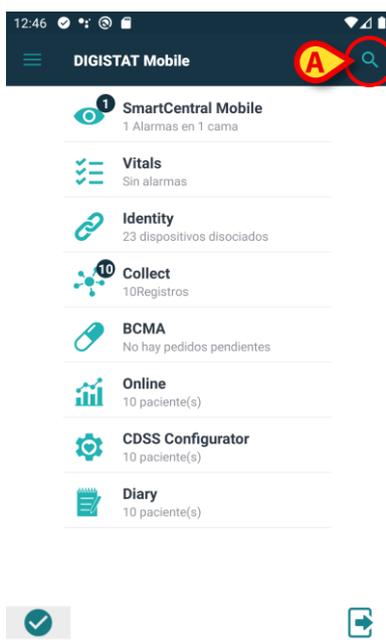


Fig 20

Se abre la siguiente pantalla (Fig 21).



Fig 21

Hay tres opciones de búsqueda disponibles:

- 1 - búsqueda textual (ver apartado 1.8.1)
- 2 - lectura de código de barras (ver apartado 1.8.2)
- 3 - lectura de código NFC (ver apartado 1.8.3)



Se puede configurar la función de búsqueda de pacientes para limitar la búsqueda de pacientes dados de alta a un intervalo de tiempo fijo. Póngase en contacto con sus administradores del sistema para conocer las opciones disponibles.

1.8.1 Búsqueda textual

- Introducir los datos del paciente en los campos indicados en Fig 22 **A** (nombre, apellidos código), y hacer clic en el botón **Buscar** (Fig 22 **B**). Se admite información parcial.

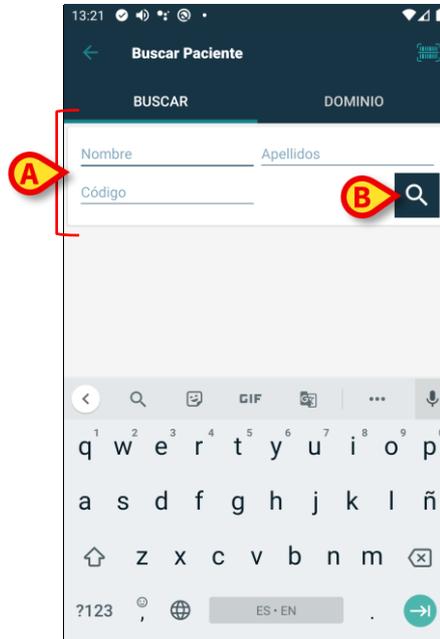


Fig 22

Se mostrará la lista de pacientes cuyos datos coinciden con los especificados (Fig 23).

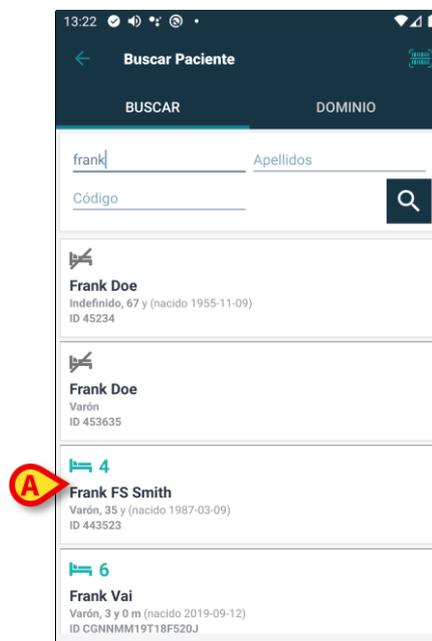


Fig 23

La búsqueda se efectúa entre todos los pacientes, tanto si pertenecen al dominio del dispositivo como si no pertenecen al mismo. Si el paciente se encuentra actualmente en cama, se mostrarán el icono  y el número de la cama; en caso contrario, aparecerá el icono .

- Tocar la casilla correspondiente a un paciente para seleccionarlo. Se necesita confirmación de usuario (Fig 24).



Fig 24

- Tocar **Ok** para confirmar.

De ese modo queda seleccionado el paciente (Fig 25).



Fig 25

Los datos del paciente están en la parte superior de la página (Fig 25 **A**). Todos los datos en todos los módulos Mobile Launcher están ahora filtrados por paciente (es decir, se muestran todas las alarmas/notificaciones del paciente seleccionado, y solo esas).

- Tocar la cruz indicada en Fig 25 **B** para deseleccionar al paciente y volver de nuevo al modo “Todos los pacientes”.



Si junto al nombre del paciente aparece el icono de un candado (🔒), significa que algunas funcionalidades no están disponibles para dicho paciente.

1.8.2 Búsqueda por lectura de código de barras

La función de lectura de código de barras permite seleccionar un paciente pasando su código por el lector.

Para acceder a la función Lectura de código de barras en dispositivos que no sean Myco 3:

- Acceder a la página de búsqueda según se explica en el apartado 1.8.
- Tocar el icono  indicado en Fig 26 **A**.



Fig 26

De ese modo se activará el dispositivo cámara.

- Pasar el código de barras del paciente buscado.

Para acceder a la funcionalidad de escaneo de código de barras en dispositivos Myco 3:

- Acceda a la página de búsqueda, según se indica en el párrafo 1.8.
- Pulse el botón lateral reservado al escaneo de código de barras (el botón indicado en Fig 26 **A** no está presente en este caso).

La cámara del flash se enciende para ayudar al usuario a captar correctamente el código de barras. Al mismo tiempo, se muestra un mensaje al usuario indicando el escaneo de códigos de barras.

De ese modo queda seleccionado el paciente. Aparecerá la pantalla que se muestra en Fig 25 (ejemplo). Si el código de barras no se encuentra dentro de un tiempo configurado determinado, aparecerá un mensaje de "Tiempo de espera".

1.8.3 Búsqueda mediante Lector NFC

El Lector NFC permite seleccionar un paciente usando el sensor de Near Field Communication (Comunicación de campo cercano) del dispositivo.

Para hacerlo:

- Acceder a la página de búsqueda según se explica en el apartado 1.8.

De ese modo se activará el dispositivo Lector NFC.

- Acercar el dispositivo a la etiqueta del paciente.

De ese modo queda seleccionado el paciente. Aparecerá la pantalla que se muestra en Fig 25.

1.8.4 Selección de un solo paciente

Para seleccionar un solo paciente

- Toque el icono  indicado en Fig 20 **A** . Aparecerá la siguiente pantalla (Fig 27 **A**):



Fig 27

- Toque la pestaña «DOMINIO» Aparecerá la ventana siguiente (Fig 28)

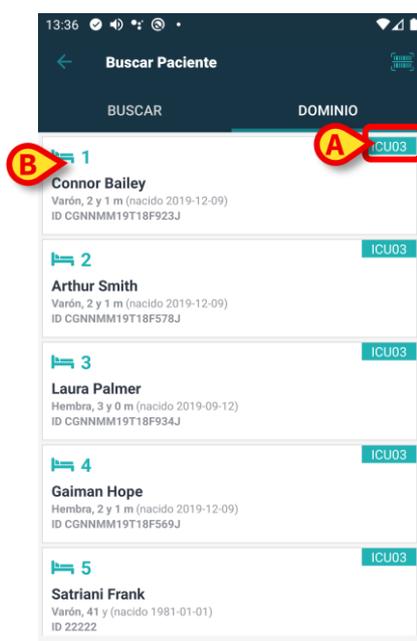


Fig 28

En la Fig 28 aparecen todos los pacientes del dominio. La etiqueta de la esquina superior derecha de cada recuadro indica la unidad hospitalaria (Fig 28 **A**).

Se puede seleccionar un solo paciente tocando el mosaico correspondiente a su cama. Por ejemplo:

- Toque el mosaico indicado en Fig 28 **B**. Se requiere confirmación del usuario (Fig 29).

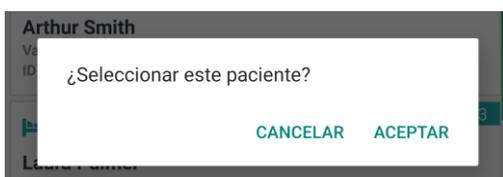


Fig 29

- Toque **Aceptar** para confirmar. Después de la confirmación, aparecerá la siguiente pantalla.



Fig 30

Los datos del paciente están en la parte superior de la página (Fig 30 **A**). Todos los datos en todos los módulos Mobile Launcher están ahora filtrados por paciente (es decir, se muestran todas las alarmas/notificaciones del paciente seleccionado, y solo esas).

- Tocar la cruz indicada en Fig 30 **B** para deseleccionar al paciente y volver de nuevo al modo “Todos los pacientes”.

1.9 Funciones de búsqueda de pacientes (iOS)

El Producto implementa varias herramientas de búsqueda de pacientes. Se accede a ellas desde la pantalla Lista de Pacientes.

Para acceder a las funcionalidades de búsqueda

- Toque el icono indicado en Fig 31 **A**.

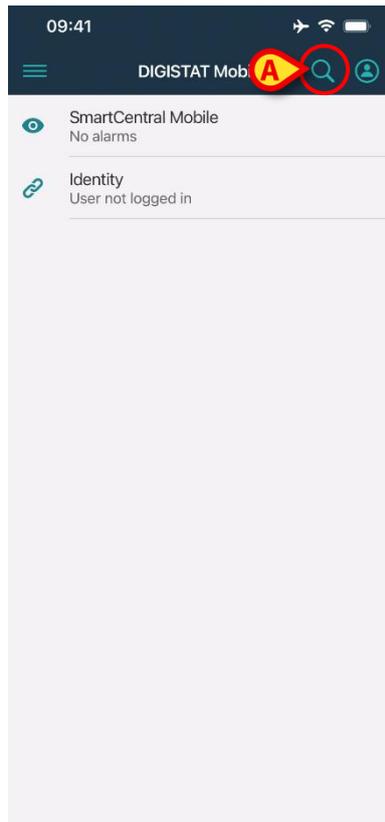


Fig 31

Se abre la siguiente pantalla (Fig 32).

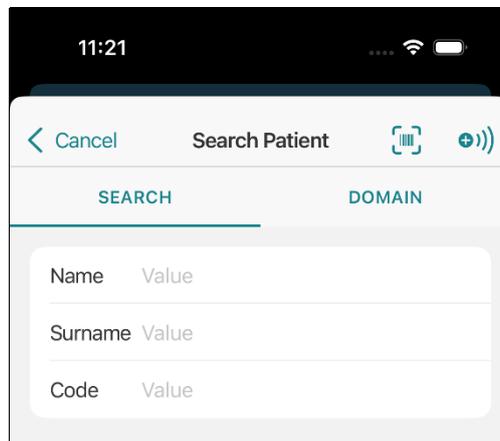


Fig 32

Hay tres opciones de búsqueda disponibles:

- 1 - búsqueda textual (ver apartado 1.9.1)
- 2 - lectura de código de barras (ver apartado 1.9.2)
- 3 - lectura de código NFC (ver apartado 1.9.3)

1.9.1 Búsqueda textual

- Introducir los datos del paciente en los campos indicados en Fig 33 **A** (nombre, apellidos código). Se admite información parcial.

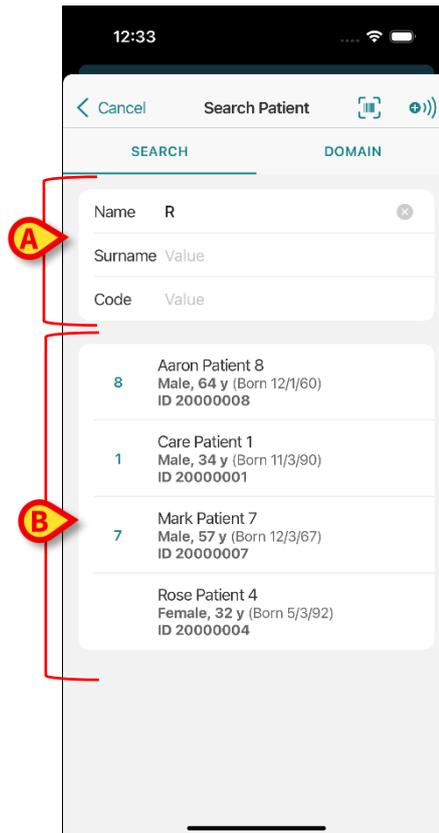


Fig 33

Se mostrará la lista de pacientes cuyos datos coinciden con los especificados (Fig 33 **B**).

La búsqueda se efectúa entre todos los pacientes, tanto si pertenecen al dominio del dispositivo como si no pertenecen al mismo. Si el paciente ocupa actualmente una cama, se muestra el número de cama y, si el paciente no ocupa ninguna cama, no se muestra el número de cama.

- Tocar la casilla correspondiente a un paciente para seleccionarlo. Se necesita confirmación de usuario (Fig 34).

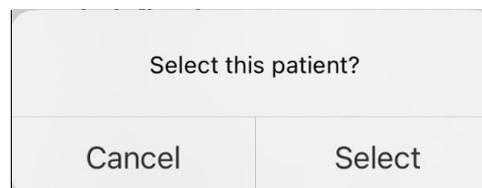


Fig 34

- Toque **Select** (Seleccionar) para confirmar.

De ese modo queda seleccionado el paciente (Fig 35).

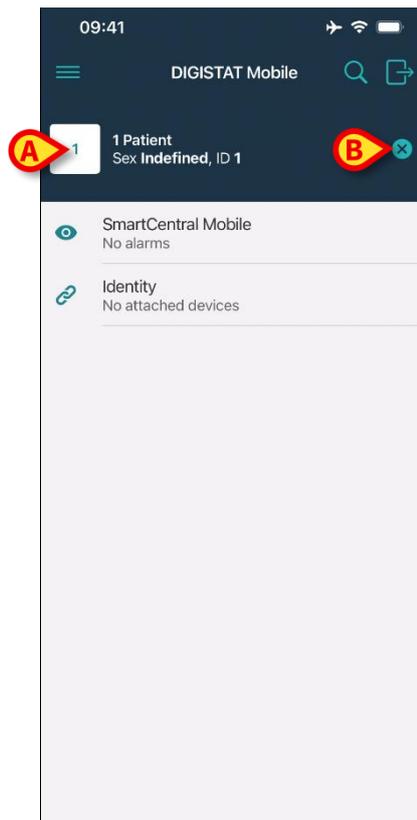


Fig 35

Los datos del paciente están en la parte superior de la página (Fig 35 **A**). Todos los datos en todos los módulos Mobile Launcher están ahora filtrados por paciente.

- Tocar la cruz indicada en Fig 35 **B** para deseleccionar al paciente y volver de nuevo al modo “Todos los pacientes”.



Si junto al nombre del paciente aparece el icono de un candado (🔒), significa que algunas funcionalidades no están disponibles para dicho paciente.

1.9.2 Búsqueda por lectura de código de barras

La función de lectura de código de barras permite seleccionar un paciente pasando su código por el lector.

Para acceder a la función Lectura de código de barras en dispositivos que no sean Myco 3:

- Acceder a la página de búsqueda según se explica en el apartado 1.9.
- Tocar el icono  indicado en Fig 36 **A**.

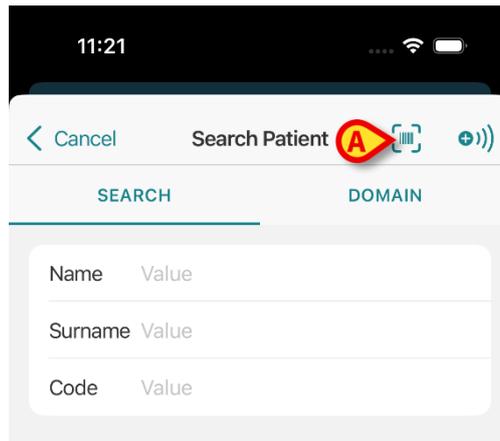


Fig 36

De ese modo se activará el dispositivo cámara.

- Pasar el código de barras del paciente buscado.

La cámara del flash se enciende para ayudar al usuario a captar correctamente el código de barras. Al mismo tiempo, se muestra un mensaje al usuario indicando el escaneo de códigos de barras.

De ese modo queda seleccionado el paciente. Aparecerá la pantalla que se muestra en Fig 35 (ejemplo). Si el código de barras no se encuentra dentro de un tiempo configurado determinado, aparecerá un mensaje de "Tiempo de espera".

1.9.3 Búsqueda mediante Lector NFC

El Lector NFC permite seleccionar un paciente usando el sensor de Near Field Communication (Comunicación de campo cercano) del dispositivo.

Para hacerlo:

- Acceder a la página de búsqueda según se explica en el apartado 1.9.
- Tocar el icono  indicado en Fig 37 A.

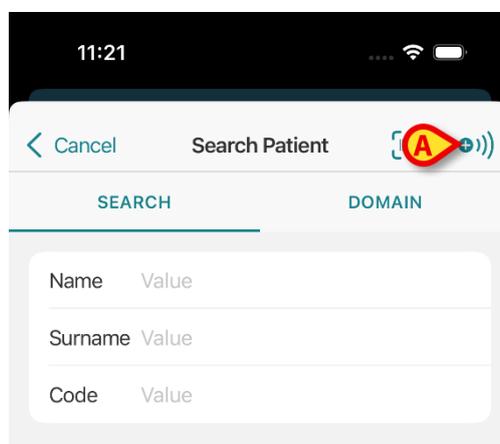


Fig 37

De ese modo se activará el dispositivo Lector NFC.

- Acercar el dispositivo a la etiqueta del paciente.

De ese modo queda seleccionado el paciente. Aparecerá la pantalla que se muestra en Fig 35 (Ejemplo).

1.9.4 Selección de un solo paciente

Para seleccionar un solo paciente

- Toque el icono  indicado en Fig 31 A . Aparecerá la siguiente pantalla (Fig 38 A):

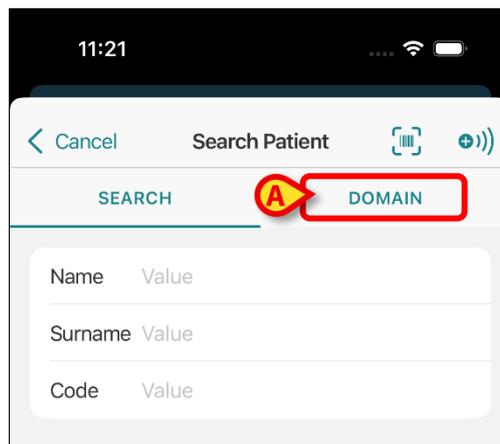


Fig 38

- Toque la pestaña «DOMINIO» Aparecerá la ventana siguiente (Fig 39)

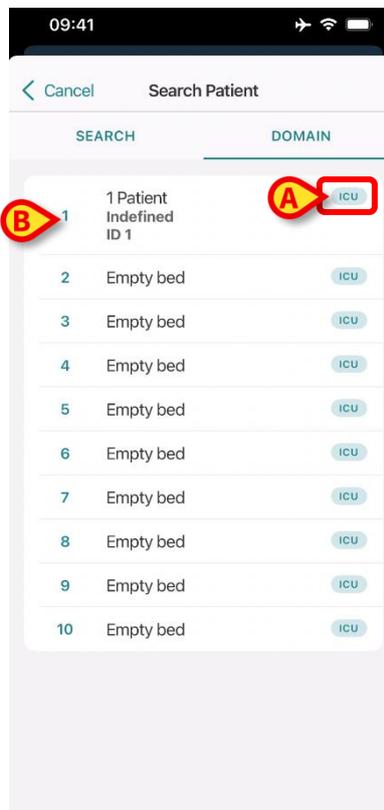


Fig 39

En la Fig 28 aparecen todos los pacientes del dominio. La etiqueta de la esquina superior derecha de cada recuadro indica la unidad hospitalaria (Fig 39 **A**).

Se puede seleccionar un solo paciente tocando el mosaico correspondiente a su cama. Por ejemplo:

- Toque el mosaico indicado en Fig 39 **B**. Se requiere confirmación del usuario (Fig 40).

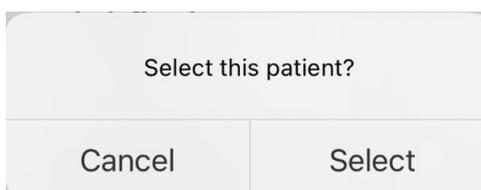


Fig 40

- Toque **Select** (Seleccionar) para confirmar. Después de la confirmación, aparecerá la siguiente pantalla.

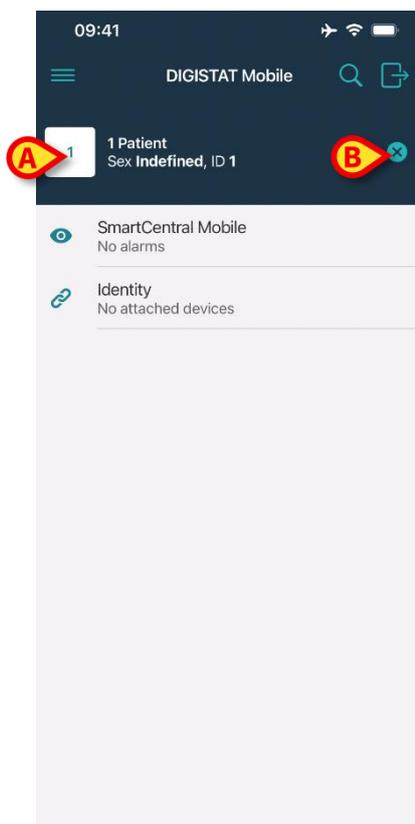


Fig 41

Los datos del paciente están en la parte superior de la página (Fig 41 **A**). Todos los datos en todos los módulos Mobile Launcher están ahora filtrados por paciente.

- Tocar la cruz indicada en Fig 41 **B** para deseleccionar al paciente y volver de nuevo al modo "Todos los pacientes".

1.10 Funcionalidad de Asignación de Pacientes



Funciones no disponibles en iOS.

Funcionalidad de Asignación de Pacientes permite al usuario seleccionar uno o varios pacientes y crear un "grupo" de pacientes que están bajo su cargo. El nombre de este grupo en la aplicación Mobile Launcher es «Mis pacientes».

Ya que el usuario se asigna algunos pacientes, en el dispositivo de mano pueden mostrarse las siguientes notificaciones:

- Las notificaciones en relación con los pacientes asignado (es decir, en el grupo "Mis pacientes");
- Las notificaciones en relación con los pacientes asignado (es decir, en el grupo "Mis pacientes") y las relacionadas con los pacientes de los que nadie se ha hecho cargo explícitamente;
- Las notificaciones en relación con los pacientes asignado (es decir, en el grupo "Mis pacientes"), las relacionadas con los pacientes de los que nadie se ha hecho cargo explícitamente y las relacionadas con los demás pacientes si los dispositivos que se hacían cargo de ellos los "pierden" (por alguna razón, como por ejemplo si la señal wi-fi no tiene fuerza suficiente).

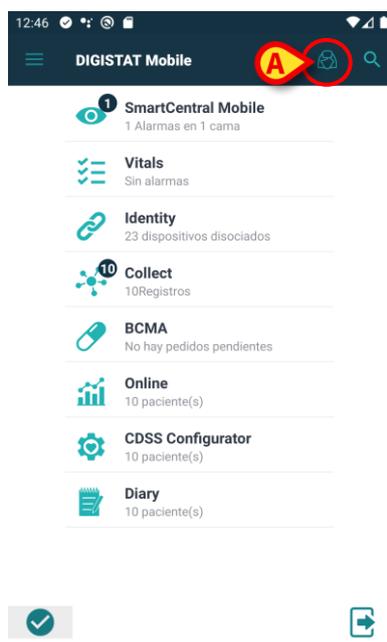


Fig 42

Para seleccionar la lista de pacientes un usuario se asigna a sí mismo y que forman la lista "Mis pacientes", en la pantalla Mobile Launcher Central,

- Tocar el  icono (Fig 42 A).

Se visualiza la siguiente pantalla (Fig 43 - "Configuración Mis pacientes").



Fig 43

Para seleccionar/deseleccionar un paciente, hay que tocar el “recuadro” correspondiente. Cada recuadro corresponde a una cama. Además, el usuario puede seleccionar o anular la selección de todos los pacientes marcando la casilla en la esquina superior derecha (Fig 44 **A**).

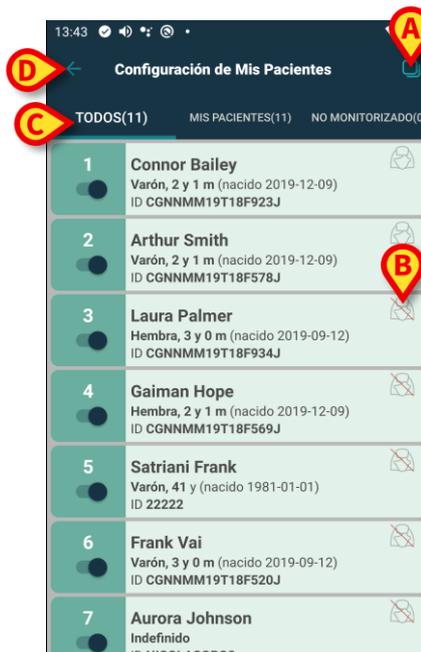


Fig 44

Los iconos a la derecha de los nombres de los pacientes (Fig 44 **B**) tienen los siguientes significados:

-  - El Paciente es parte de "Mis pacientes" de otro usuario. El paciente todavía se puede seleccionar. Si dos usuarios seleccionan al mismo paciente, el paciente estará agrupado bajo "Mis pacientes" para ambos usuarios.

 - El Paciente no está monitorizado. P.ej. está a cargo de otro usuario, pero de momento, debido (por ejemplo) a un fallo de la conexión wi-fi, nadie lo está monitorizando.

La ausencia de icono significa que nadie tiene al paciente en su lista de "Mis pacientes", de modo que el paciente no está monitorizado.

Los filtros indicados en Fig 44 **C** permiten visualizar:

- todos los pacientes;
- solamente los pacientes asignado ("Mis pacientes");
- solo los pacientes que no están monitorizados.

El icono  indicado en Fig 44 **D** permite volver a la pantalla con la lista de "Mis pacientes".



Se puede configurar Mobile Launcher para asignar automáticamente el dispositivo móvil a todos los pacientes concernidos. En este caso, no es necesario gestionar manualmente el grupo "MyPatients". Los iconos  /  no aparecen. Lea el documento *DSO ENG System Options* para obtener más información.

1.11 Selección/asignación de pacientes, módulos y dominio

En el presente documento, la frase «selección/asignación de pacientes» se ha utilizado para referirse genéricamente a las operaciones en las que se selecciona a un paciente para realizarle algunas operaciones en el entorno Mobile Launcher. Para algunos módulos de Digistat Mobile, es más preciso referirse a este proceso como "selección/asignación de cama".

Las principales diferencias se detallan a continuación:

- Una aplicación puede funcionar dentro del dominio o sin él;
 - Los módulos Smart Central y Vitals funcionan dentro del dominio. Esto implica que pueden seleccionar camas o pacientes dentro del mismo dominio del usuario;
 - El módulo Identity puede funcionar de tres maneras diferentes, según una opción específica del sistema: 1. Sin dominio, lo que significa que Identidad puede establecer una asociación paciente/dispositivo también para pacientes fuera del dominio del usuario; 2. Dentro del dominio; 3. Con un único paciente preseleccionado. La primera opción (sin dominio) no está disponible en iOS. Encontrará más información en el manual de usuario de Identity Mobile (documento USR ESP Identity Mobile).
- Una aplicación que opere en el dominio puede gestionar camas o pacientes;
 - El módulo Smart Central gestiona la selección de camas (porque podría ser importante rastrear los datos de los dispositivos que vienen de una cama ocupada por un paciente aún no identificado). Esto implica que Smart Central puede seleccionar o asignar camas vacías;

- El módulo Vitals gestiona la selección de pacientes (porque se supone que la adquisición de parámetros planificada se realiza en los pacientes aún ingresados e identificados). Esto implica que Vitals no puede seleccionar una cama vacía.

Hay dos formas de definir un dominio (es decir, la lista de pacientes gestionados por un dispositivo concreto), En Android, esto depende de la opción del sistema *Userrightsmode*; consulte a los administradores del sistema para obtener más información:

- El dominio se define por el dispositivo. En ese caso, después de un cambio de usuario el dominio se mantiene.
- El dominio se define por el usuario, basándose en las ubicaciones hospitalarias asociadas a este. En ese caso, tras un cambio de usuario, el dominio también cambia.

1.12 Disponibilidad del dispositivo



Funciones no disponibles en iOS.

La configuración de la disponibilidad del dispositivo es útil si el usuario debe considerarse como "no disponible" de forma temporal. El usuario puede activar dicha configuración en la aplicación móvil o (si está configurado) colocando el dispositivo en su estación de acoplamiento.

1.12.1 Configuración por el usuario

Dentro de la aplicación móvil del producto, el usuario puede configurar el dispositivo como «no disponible». Para todos los dispositivos de su sala, las camas que pertenecen al dispositivo «no disponible» se considerarán como «desatendidas». No obstante, el dispositivo configurado como "no disponible" continúa recibiendo alarmas y mensajes. En este caso, dichas alarmas continuarán generando sonidos y/o vibraciones.

- Pulse el símbolo en Fig. 45A para configurar el dispositivo como «no disponible»;

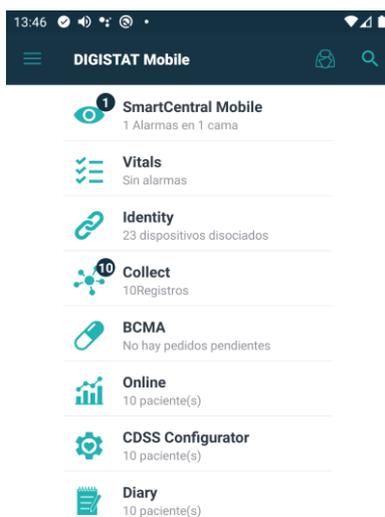


Fig. 45

Se necesita la confirmación del usuario.

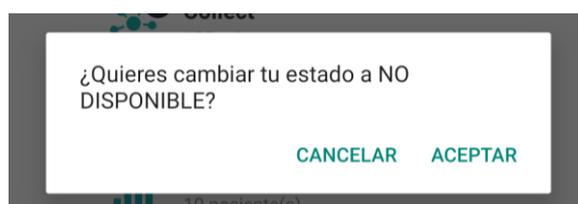


Fig. 46

- Pulse **ACEPTAR** para configurar el dispositivo como «no disponible».

El Launcher de la página principal podrá modificarse según se muestra en Fig. 47.

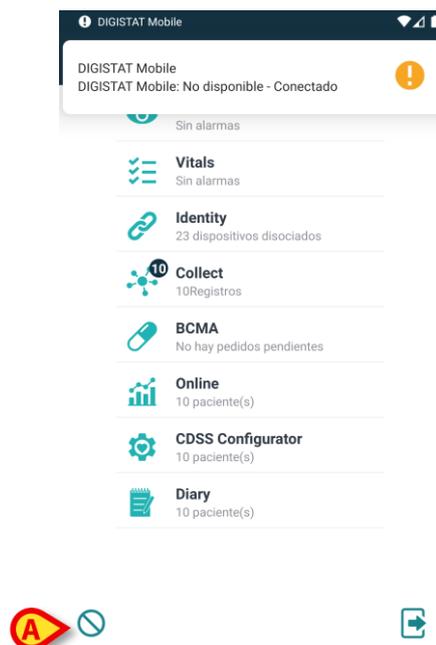


Fig. 47

- Pulse el símbolo en Fig. 47 **A** para configurar el dispositivo como «disponible»;

Se necesita la confirmación del usuario.

Aparecerá el siguiente mensaje de diálogo, solicitando una confirmación por parte del usuario:

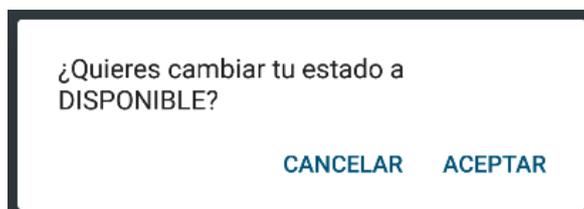


Fig. 48

- Pulse **OK** para configurar el dispositivo como «disponible».

1.12.2 Configuración mediante la estación de acoplamiento



Funciones no disponibles en iOS.

La estación de acoplamiento es un dispositivo accesorio que permite cargar dispositivos móviles y mantener la conexión de red. Puede alojar una cierta cantidad de dispositivos móviles, lo que le permite al usuario cambiar un dispositivo no cargado con uno cargado por completo.

Se debe establecer un parámetro de configuración específico para considerar el dispositivo como «no disponible» si se coloca en la estación de acoplamiento.

Las camas que son propiedad del dispositivo «no disponible» se considerarán como «desatendidas» y se cerrará la sesión del usuario. No obstante, el dispositivo configurado como «no disponible» permanece conectado al servidor móvil y continúa recibiendo alarmas y mensajes.

En este caso, tales alarmas no dispararán ningún sonido o vibración.

1.13 Widgets



Funciones no disponibles en iOS.

El Producto implementa un conjunto de widgets, es decir, controles gráficos destinados a facilitar algunas acciones específicas del usuario.

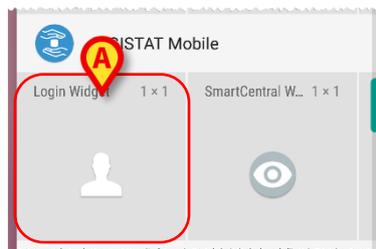


Fig. 49

En el presente párrafo se mostrará el widget relacionado con el entorno móvil del Producto en general.

1.13.1 Widget de inicio de sesión

El Widget de inicio de sesión permite al usuario autenticarse en la aplicación móvil del producto, así como buscar y seleccionar pacientes. Para utilizar esta función, el usuario debe realizar las siguientes acciones:

- Pulse el icono que se muestra en Fig. 49 **A** y suéltelo en la pantalla del dispositivo.

El Widget de inicio de sesión por defecto se colocará en la pantalla del dispositivo con el tamaño 1 x 1 (Fig. 50)



Fig. 50

- Pulse el icono en Fig. 50 **A** para autenticarse en el Producto (Fig. 51).

Digistat Mobile

Nombre de usuario Contraseña



Fig. 51

Después de la autenticación, el Widget de inicio de sesión muestra el usuario que actualmente está conectado:



Fig. 52

- Mantenga pulsado el icono en Fig. 50 **A** o Fig. 52 **A** y luego suéltelo para mostrar los puntos de agarre para cambiar el tamaño del widget (Fig. 53: izquierda si el usuario no está registrado, derecha si está registrado):



Fig. 53

- Toque y mueva uno de los dos puntos de agarre y luego empuje el fondo del escritorio para cambiar el tamaño del widget a 2 x 1, 3 x 1, 4 x 1:

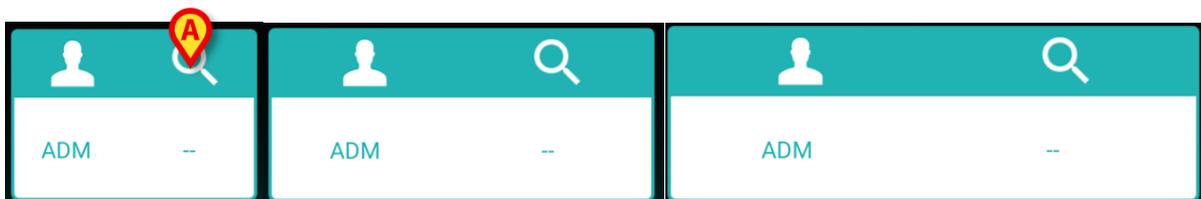


Fig. 54

- Toque el icono en Fig. 54 **A** para acceder a la funcionalidad de búsqueda y selección de pacientes (Fig. 55).

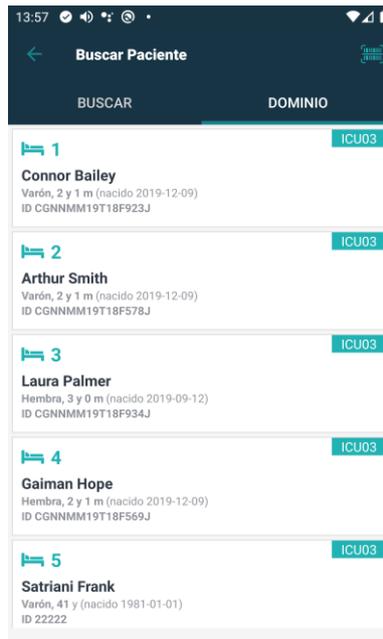


Fig. 55

Esta función solo es accesible si el usuario ha iniciado sesión. Si el usuario no ha iniciado sesión y se pulsa el icono en Fig. 54 **B**, se muestra además la ventana de autenticación. Después de seleccionar el paciente, el widget de inicio de sesión muestra el paciente actualmente seleccionado (Fig. 56):




Fig. 56

- En esta situación, toque de nuevo el Widget de inicio de sesión para mostrar la página principal de la aplicación móvil.

Tenga en cuenta que con el tamaño 2 x 1 del Widget algunos nombres de pacientes pueden resultar demasiado largos para visualizarse correctamente. En este caso, es recomendable volver a ampliar el tamaño del Widget. Se puede cambiar el tamaño del Widget de inicio de sesión a 3 x 1, 4 x 1 y 5 x 1:

Si el usuario cierra la sesión mientras está seleccionado un paciente, el Widget de inicio de sesión mostrará una «pantalla en blanco», es decir, no se mostrará ningún usuario ni ningún paciente.

2. Módulo de estadísticas de alarmas



Funciones no disponibles en iOS.

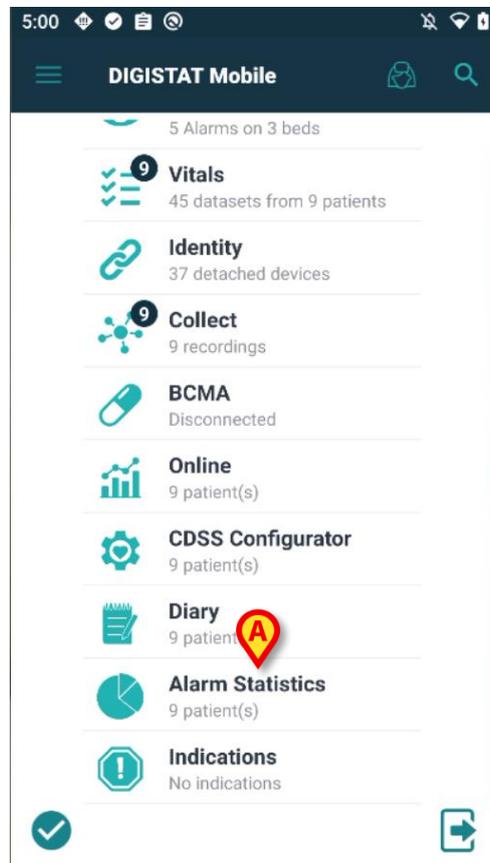


Fig. 57

El módulo de estadísticas de alarmas muestra esta información en forma de gráficos de barras y circulares e informes resumidos y detallados para un paciente seleccionado.

Para explorar el **módulo de estadísticas de alarmas**,

- solo tiene que iniciar **Digistat Mobile** y el recuadro correspondiente aparecerá en la página del launcher, entre otros módulos instalados (Fig. 57 A).

Debajo del nombre del módulo se muestra el número de pacientes presentes en el dominio actual. El módulo no requiere que un usuario haya iniciado la sesión.

Al hacer clic en el recuadro de **estadísticas de alarmas**, se abrirá una nueva página en la que se mostrará la lista de tarjetas de los pacientes divididas en dos grupos («**Mis pacientes**» y «**Pacientes no asignados**»), junto con el número de cama, los datos de cada paciente (sexo, edad, fecha de nacimiento e identificador) y la miniatura de los gráficos de barras. Las camas vacías se excluyen de la lista.

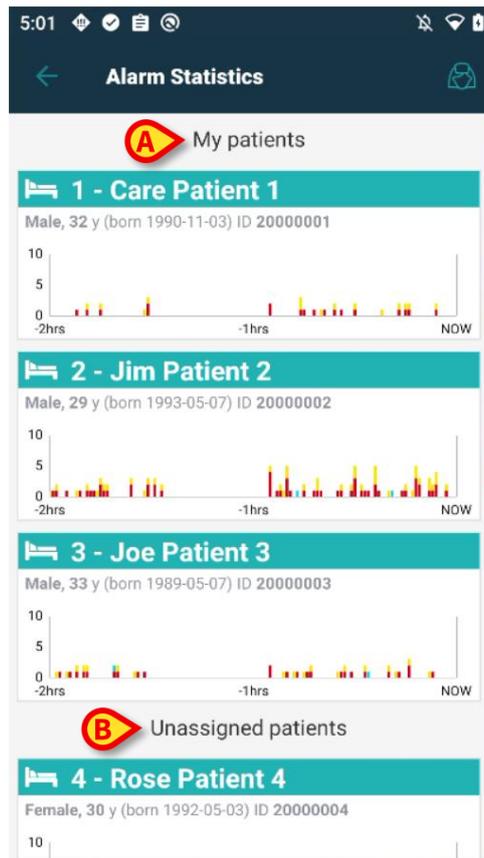


Fig. 58

Cada gráfico muestra las últimas alarmas del paciente correspondiente.

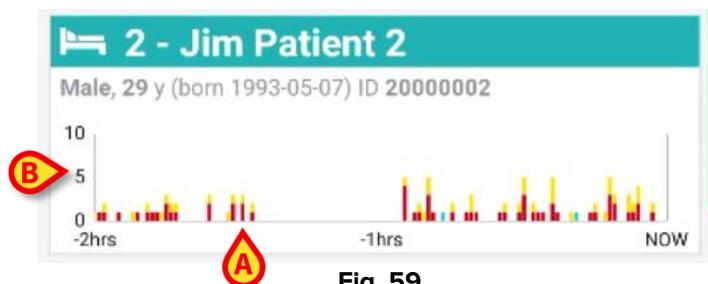


Fig. 59

En el eje x (Fig. 59 **A**) se representa el tiempo, mientras que en el eje y (Fig. 59 **B**) se registra y se muestra el número de alarmas como barras de diferentes alturas y con los colores de prioridad convencionales en función de los diferentes tipos de alarma (prioridad alta, media y baja). El gráfico muestra las alarmas, desde la más antigua a la más reciente, de izquierda a derecha. Si no se ha registrado ninguna alarma en el intervalo de tiempo de referencia (en este caso, 2 horas), no se mostrará el gráfico. Para acceder a la **vista detallada de las estadísticas del paciente**,

- haga clic en la **tarjeta del paciente**.

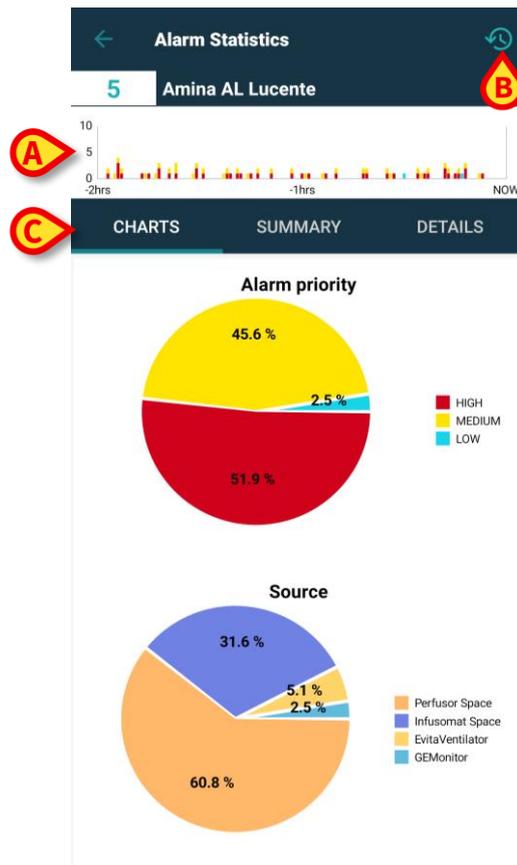


Fig. 60

Aparecerá una nueva página y, en la parte superior (debajo del nombre del paciente y el número de cama), el mismo **gráfico de barras** (Fig. 60 A) que se mostraba como miniatura en el listado de pacientes. En la parte superior derecha de la barra de acciones se muestra un **icono de intervalo de tiempo** (Fig. 60 B). En la parte central, se observan **tres pestañas** (Fig. 60 C). La primera está seleccionada por defecto.

Para más información sobre la función y el uso del módulo de **estadísticas de alarmas**, consulte el manual de usuario de Smart Central Mobile (*USR ESP Smart Central Mobile*).

3. Módulo de indicaciones



Funciones no disponibles en iOS.

El módulo de indicaciones está pensado para mostrar advertencias o avisos persistentes (las indicaciones son similares a las alarmas pero pueden durar horas o indefinidamente y no generan notificaciones del sistema Android) generados por diferentes componentes del marco Digistat sobre sucesos preocupantes o recordatorios importantes relacionados con un paciente o una acción concretos o bien con un estado de la estación de trabajo. Ejemplos: un paciente es alérgico a X, un paciente tiene problemas mentales, no se ha introducido aún la puntuación X, etc.

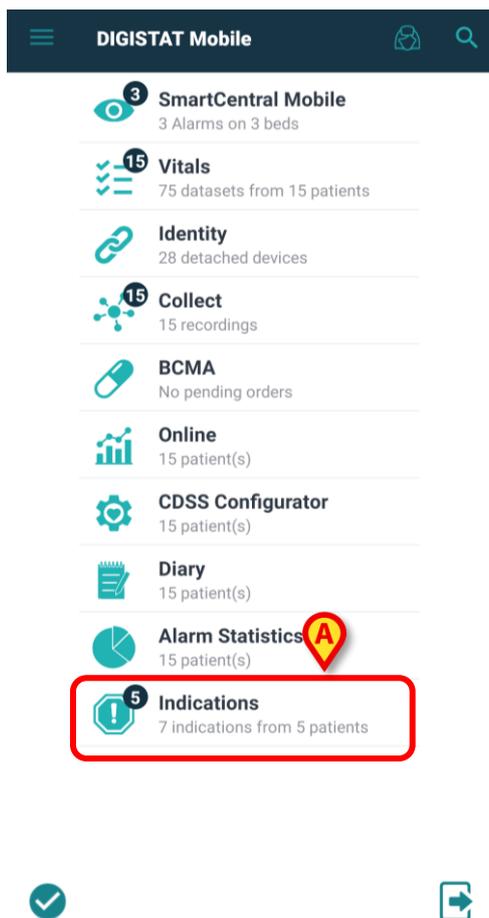


Fig. 61

Para abrir el módulo de indicaciones, solo tiene que iniciar Digistat Mobile y el recuadro correspondiente aparecerá entre otros módulos instalados (Fig. 61 **A**).

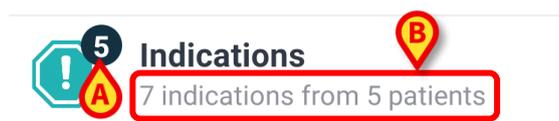


Fig. 62

En el icono de indicaciones aparece un distintivo con un número, que representa el número de camas o pacientes que presentan al menos una indicación (Fig. 62 **A**) cuya prioridad va más allá del carácter informativo. Debajo del nombre del módulo se indica el número de indicaciones provenientes de los pacientes presentes en el dominio actual (Fig. 62 **B**).

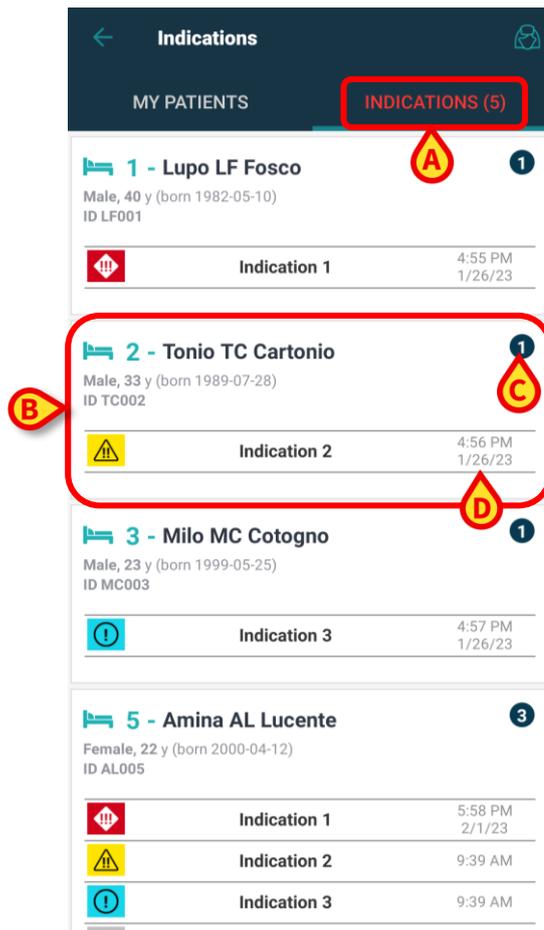


Fig. 63

Si hay como mínimo una indicación, al hacer clic en el recuadro de **indicaciones** se abrirá una nueva página en la pestaña de **indicaciones** (Fig. 63 **A**) en la que se mostrará la **lista de pacientes** (Fig. 63 **B**) con las tarjetas en las que aparecen los datos de cada uno de ellos (**nombre, sexo, fecha de nacimiento e identificador**), un **distintivo** con el número de indicaciones (Fig. 63 **C**) en la parte superior derecha de la tarjeta y la **indicación o lista de indicaciones** (ordenadas por gravedad o prioridad) junto con el icono, recuadro y fecha/hora correspondientes (Fig. 63 **D**). Si la indicación se refiere al día en curso, solo se señala la hora. Las indicaciones de carácter informativo se muestran pero no se incluyen en el recuento.

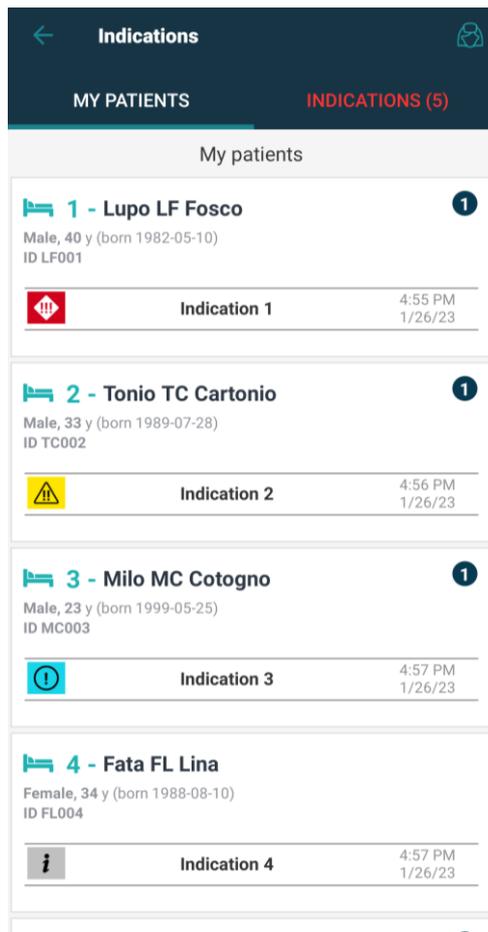


Fig. 64

Al hacer clic en la pestaña «**Mis pacientes**», se muestra la visualización relativa (que ya se ha explicado y es la misma en todos los módulos de Digistat Mobile) y se incluye también a los pacientes sin indicaciones activas.

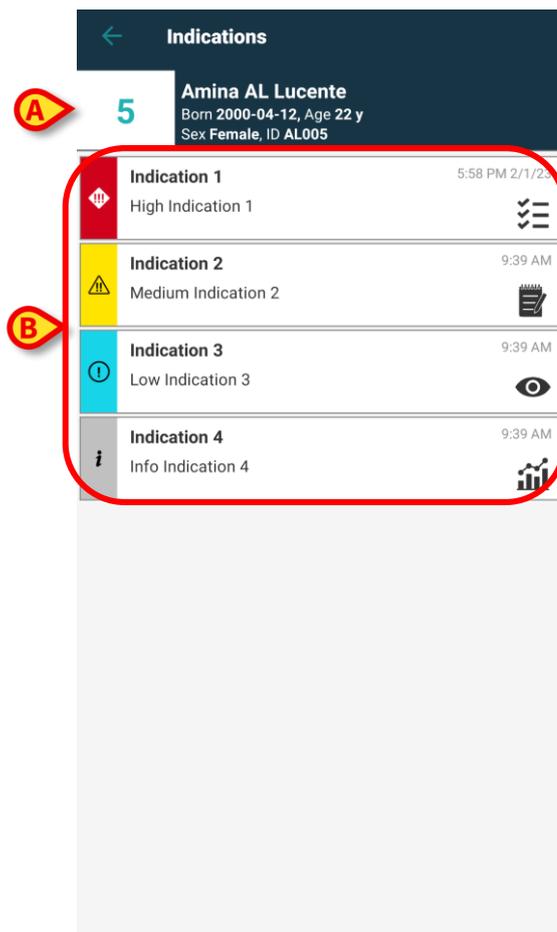


Fig. 65

Para acceder a la vista detallada de un paciente, seleccione el recuadro correspondiente. En la parte superior de la página aparecen el **número de cama** y los **datos del paciente**. En la parte central, se enumeran las **indicaciones** ordenadas por **prioridad** y, acto seguido, por **fecha** (de las que tienen la prioridad más alta a las que no revisten prioridad, de la más reciente a la más antigua).

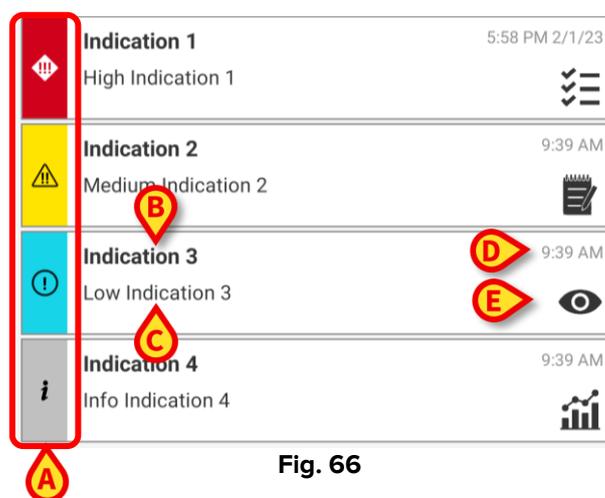


Fig. 66

La tarjeta de cada indicación contiene el **icono de prioridad** (Fig. 66 A), el **recuadro** (Fig. 66 B) y la **descripción** (Fig. 66 C) de la indicación (si no hay descripción, se ofrece un resumen en su lugar), la **fecha** y la **hora** (Fig. 66 D) y un **icono opcional** (Fig. 66 E) del módulo al que se refiere la indicación.

El ejemplo (Fig. 66) muestra 4 indicaciones de diferente tipología:

- una de prioridad alta relacionada con el módulo **Vitals Mobile**;
- una de prioridad media relacionada con el módulo **Diary Mobile**;
- una de prioridad baja relacionada con el módulo **Smart Central Mobile**;
- una indicación de carácter informativo relacionada con el módulo **Online Mobile**.

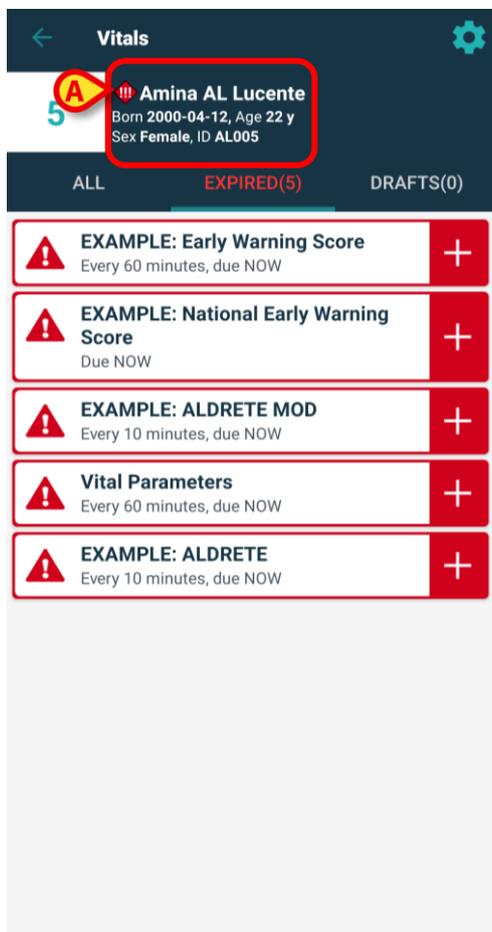


Fig. 67

Al hacer clic en una **indicación**, es posible acceder a módulos conectados sin necesidad de ir a la página del launcher. Si un paciente presenta una o más indicaciones, junto a su nombre se muestra el **icono de alerta de mayor gravedad o prioridad** (Fig. 67 **A**), en la tarjeta del paciente de la vista detallada de cada módulo Digistat. Si la indicación tiene una prioridad de carácter informativo, no se muestra ningún icono. En las imágenes siguientes se observan pacientes con indicaciones de diferentes niveles de prioridad, en módulos también diferentes.

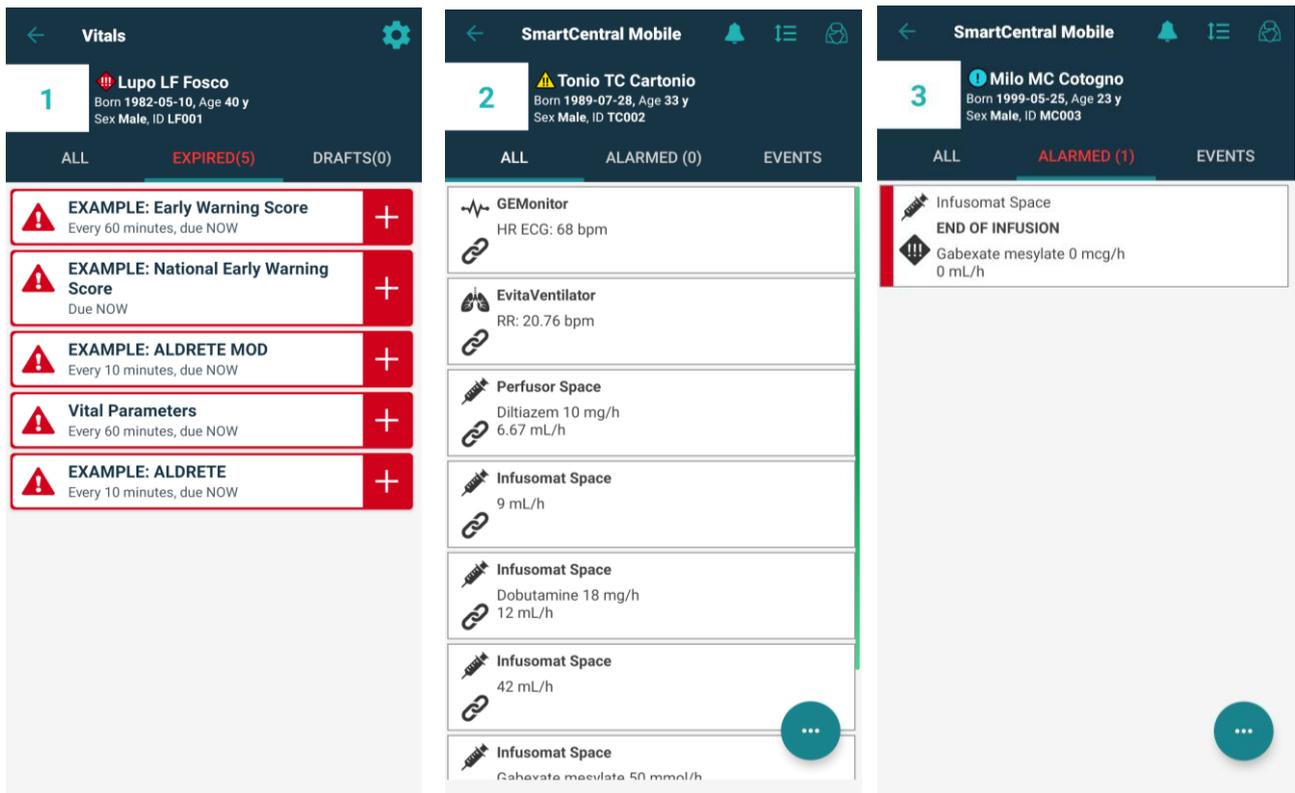


Fig. 68

Al hacer clic en el **icono de indicación** en la tarjeta del paciente (Fig. 69 A), el usuario accede a la página del módulo en la que puede leer íntegramente el contenido de la indicación activa y, dado el caso, ver la lista de todas las indicaciones (Fig. 69 B) disponibles para dicho paciente.

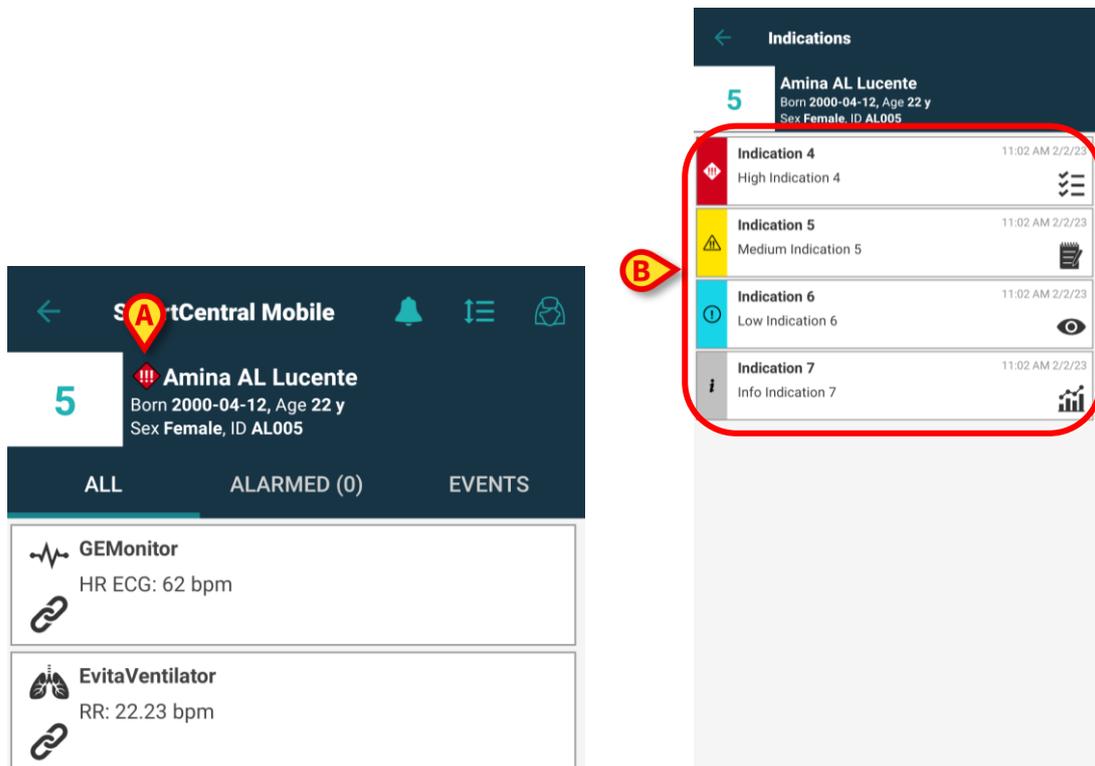


Fig. 69