



Control Bar Web Användarmanual

Version 5.0

10/3/2025

Ascom UMS s.r.l. Unipersonale
Via Amilcare Ponchielli 29, 50018, Scandicci (FI), Italy
Tel. (+39) 055 0512161 – Fax (+39) 055 829030
www.ascom.com

Innehåll

1. Control Bar Web	3
1.1 Starta Control Bar Web	3
1.2 inloggning	4
1.2.1 Automatisk inloggning	6
1.2.2 Logga ut och förbli.....	7
1.3 Arbetsyta	8
1.3.1 Välja en modul	8
1.4 Control Bar.....	9
1.5 Huvudmeny	10
1.5.1 Ändra lösenord	11
1.5.2 Rapportering av användarproblem	12
1.6 Ytterligare undermoduler	13
1.6.1 CDSS-konfigurator	13
1.6.2 Identitet.....	15

1. Control Bar Web



För information om produktmiljön, försiktighetsåtgärder, varningar och avsedd användning se *USR SWE Digistat Care* och/eller *USR SWE Digistat Docs* (beroende på installerade moduler - för *Digistat Suite EU*) eller *USR ENG Digistat Suite NA* (för *Digistat Suite NA*) . Kunskap om och förståelse av tillämpliga dokument är nödvändiga för en korrekt och säker användning av *Control Bar Web*, som beskrivs i detta dokument.

1.1 Starta Control Bar Web

Så här startar du Control Bar Web:

- Skriv in den specifika adressen i webbläsarens adressfält.


Följande sida öppnas:

Figur 1

1.2 inloggning

Inloggning krävs för att aktivera systemfunktionerna.

login



Username

Password

login

Figur 2

Att logga in:

- Ange ditt användarnamn i fältet "Användarnamn" (Figur 2 **A**).
- Ange ditt lösenord i fältet "Lösenord" (Figur 2 **B**).
- Klicka på knappen **Logga in** (Figur 2 **C**).



Användarnamnet och lösenordet utfärdas av systemadministratören.

Efter åtkomst till systemet visas en förkortning som motsvarar den inloggade användaren vid **Användare** på Control Bar (förkortningen är ADMIN i Figur 3 **A**).



Figur 3

Den användare vars autentiseringsuppgifter visas på vid Användare är ansvarig för alla åtgärder som utförs på produkten.



Obs: Vissa undantag är möjliga beroende på konfigurationen av din installation (t.ex. funktionerna "Automatisk inloggning" eller "Logga ut och förbli" – avsnittet 1.2.1 e 1.2.2).

Det rekommenderas starkt att logga ut innan du lämnar arbetsstationen för att undvika obehörig användning av systemet.



Det är möjligt att konfigurera produkten så att den tillåter inloggning via ett externt system ("single sign on"). I dessa fall visas en särskild knapp på inloggningsskärmen.


För att logga ut, klicka på Användare i Control Bar. Följande meny öppnas (Figur 4).



Figur 4

- Klicka på **LOGGA UT** (Figur 4 **A**).

För att logga ut krävs bekräftelse av användaren. Efter bekräftelse loggas användaren ut. För att logga in igen, klicka på **Användare** igen. Skärmen som visas i Figur 2 kommer att visas igen.



Figur 5

Om användaren inte har en tidigare tillkopplad plats (se *CGF ENG Digistat Suite MDR*-handboken för konfigurering av användare-plats-koppling) är det inte möjligt att logga in på modulen. I det här fallet visas meddelandet "Ingen plats tillgänglig" (Figur 5). Dessutom finns en **Tillbaka till inloggning**-knapp för att gå tillbaka till inloggningssidan och försöka logga in igen med en ny användare, eller med samma användare efter kopplingen mellan användaren och platsen.



En "Plats" är en Digistat-konfigurationsenhet som motsvarar ett specifikt område av vårdstrukturen. Det kan till exempel vara en avdelning, en avdelning, ett operationsblock, osv., beroende på vårdstrukturens krav. Fråga systemadministratörerna om mer information.

1.2.1 Automatisk inloggning

Det är möjligt att konfigurera Digistat Web för att tillåta automatisk användarinloggning. Det betyder att när Digistat Web startas är en konfigurerad användare redan inloggad. När detta är fallet är vissa konfigurerade funktioner omedelbart tillgängliga, innan någon inloggningsprocedur utförs.

För att aktivera automatisk inloggning är det nödvändigt att konfigurera "AutoLoginUsername"-systemalternativet. Se dokumentet "DSO ENG System Options" för mer information.

När automatisk inloggning är aktiv är det fortfarande möjligt för en användare att logga in med sina personliga inloggningsuppgifter. För att göra det,

- klicka på **Användare**-knappen (Figur 6 A).

DIGISTAT Select Patient



John Doe 12:40 PM
Sep 4, 2025



Figur 6

Följande meny kommer att öppnas (Figur 7).



Figur 7

- Klicka **LOGGA IN SOM...** (Login As... - Figur 7 A).

Inloggningsskärmen kommer att visas (Figur 2). Logga in enligt beskrivningen i avsnittet 1.2.



När "AutoLoginUsername"-systemalternativet är konfigurerat är "Logout current user"-funktionaliteten (beskriven i avsnittet 1.2.2) inaktiverad.



Funktionerna "Automatisk inloggning" eller "Logga ut och förbli" är endast tillgängliga när applikationen körs inuti "Digistat Web Browser". Se installationsmanualen för Digistat Suite för mer information (INST ENG Digistat Suite).

1.2.2 Logga ut och förbli

Denna funktionalitet tillåter användaren att logga ut samtidigt som den förblir inloggad med ett användarnamn som specificerats under konfigurationen. Det betyder att efter användarutloggning förblir en vanlig användare inloggad. För att aktivera denna funktionalitet är det nödvändigt att konfigurera "LogoutAndRemainUsername"-systemalternativet. Se dokumentet "DSO ENG System Options" för mer information. När denna funktionalitet är tillgänglig är "**Logga ut aktuell användare**"-alternativet tillgänglig i Användare-menyn (Figur 9 A).

För att "logga ut och förbli",

- klicka på **Användare**-knappen (Figur 8 A).

DIGISTAT Select Patient



Figur 8

Följande meny kommer att öppnas (Figur 9).




Figur 9

- Klicka **LOGGA UT AKTUELL ANVÄNDARE** (Figur 9 A).

Autentiseringsuppgifterna för den aktuella användaren kommer att försvinna från **Användare**-knappen, medan autentiseringsuppgifterna för den vanliga konfigurerade användaren kommer att visas.

1.3 Arbetsyta

Efter inloggning visas ikonerna som motsvarar de tillgängliga Digistat webbmoduler på sidofältet (Figur 10 **A**). Arbetsyta (Figur 10 **B**) visar skärmarna och funktionerna för den valda modulen på sidofältet.



Figur 10


Control Bar (Figur 10 **C**) beskrivs från avsnitt 1.4. Den för tillfället valda modulen markeras.

1.3.1 Välja en modul

Så här väljer du en modul:

- Klicka på motsvarande ikon i sidofältet.

Ikonen kommer att markeras och modulens funktioner kommer att visas i arbetsytan.



Figur 11

1.4 Control Bar

Control Bar som visas i den övre delen av skärmen är gemensamt för alla moduler. Dess huvudsakliga egenskaper listas nedan.



Figur 12

- **Meny** (Figur 12 **A**) öppnar Control Bar Web huvudmeny. Se avsnitt 1.5 .
- **Patientknappen** (Figur 12 **B**). Om ingen patient har valts kan man klicka på den här knappen för att starta patientvalsproceduren. Efter patientval visas patientens namn och huvuddata. För inlagda patienter visas även sängnummer och avdelningsnamn. Om specifika ytterligare Control Bar Web-funktioner är tillgängliga för den valda patienten, kan man klicka på patientknappen för att visa en rullgardinsmeny som ger tillgång till dessa funktioner (se avsnittet 1.6 för mer information). Om en hänglåsikon -  - visas bredvid patientens namn betyder det att vissa patientdata/funktioner är låsta för den patienten.




Patientvalsproceduren utförs vanligtvis på webbmodulen Digistat Patient Explorer Web. Se användarhandboken för USR SWE Patient Explorer Web (dokument USR SWE Patient Explorer Web) för instruktioner om patienthanteringsfunktioner. Andra moduler kan konfigureras för patientvalet istället för Patient Explorer Web. Om så är fallet, se den specifika dokumentationen för instruktioner.

- Området som anges i Figur 12 **C** kan användas för att signalera att det finns aviseringar för användaren.
- Användare ger åtkomst till inlogging/ utloggning och möjlighet att ändra lösenord (Figur 12 **D**).
- Datum- tid (Figur 12 **E**).
- Använd **hjälp** (Figur 12 **F**) för att komma åt användarmanualen.
- Klicka på  (Figur 12 **G**) ikon för att skapa en problemrapport som ska skickas till teknisk assistans för support. Se avsnitt 1.5.2.

1.5 Huvudmeny

Meny (Figur 12 **A**) öppnar följande meny (Figur 13).

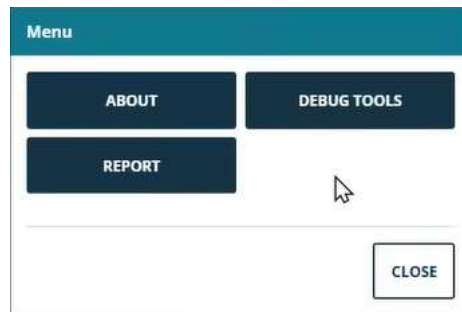

Figur 13


Om visar ett fönster som innehåller information om den installerade versionen av Digistat Suite och de relaterade licenserna (se den specifika dokumentationen för mer information). Själva märkningen av produkten är **About**-boxen som visas på klientens arbetsstationer, mobila enheter och webbmoduler där Digistat Suite är installerad.

Felsökningsverktyg är reserverad för systemadministratörer.

Rapporter -knappen öppnar ett fönster som listar de tillgängliga rapporterna (Figur 14). **Rapporter**-knappen finns både när en patient är vald och när ingen patient är vald. Om en patient väljs är de tillgängliga rapporterna de som är relaterade till patientens sjukhusenhet (märkta som "Patient"). Om ingen patient är vald är de tillgängliga rapporterna de som är relaterade till den inloggade användarens sjukhusenhet (märkt som "Generisk").



Varje användare associeras under konfiguration till en eller flera sjukhusenheter.



Figur 14

Varje rad i fönstret hänvisar till en rapportsutskrift.

- Klicka på en rad för att se en förhandsvisning.

Varje rapport kan märkas som "Patientrapport" eller "Generisk rapport" (Figur 15 **A**).



Figur 15

Knapparna som anges i Figur 15 **B** gör det möjligt att filtrera rapporterna som visas i fönstret (endast "Generiska rapporter", endast "Patientrapporter" eller alla tillgängliga rapporter).

1.5.1 Ändra lösenord


Så här ändrar du användarlösenordet:

- Klicka på **Användare** på Control Bar (Figur 16 **A**).



Figur 16

- Följande meny öppnas (Figur 17).



Figur 17

- Klicka på **Ändra lösenord** (Figur 17 **A**). Följande skärm öppnas (Figur 18).

CHANGE PASSWORD



The image shows a 'CHANGE PASSWORD' form. It consists of four input fields and a button. The first field is labeled 'Old password' and has a red circle with a yellow 'A' next to it. The second field is labeled 'New Password' and has a red circle with a yellow 'B' next to it. The third field is labeled 'Confirm new password' and has a red circle with a yellow 'C' next to it. The fourth field is a dark blue button labeled 'SAVE' and has a red circle with a yellow 'D' next to it.

Figur 18

- Skriv in det aktuella lösenordet i fältet "Gammalt-lösenord" (Figur 18 **A**)
- Skriv in det nya lösenordet i fältet "Nytt lösenord" (Figur 18 **B**).
- Upprepa det nya lösenordet i fältet "Bekräfta nytt lösenord" (Figur 18 **C**).
- Klicka på **Spara** (Figur 18 **D**).

1.5.2 Rapportering av användarproblem

Om närvarande, gör  ikonen på Control Bar (Figur 19 **A**) det möjligt att skapa en "problem"-rapport och få teknisk support.



Figur 19



*Förekomsten av ikonen beror på System Option EnableUserIssueReporting.
Hänvisa till systemadministratörerna för mer information.*

För att göra det:

- Klicka på ikonen  (Figur 19 **A**). Följande fönster öppnas (Figur 20).

Figur 20

- Ange en beskrivning av problemet i fältet "Beskrivning" (Figur 20 **A**).
- Klicka på **Skicka** (Figur 20 **B**).

En bekräftelse tillhandahålls, inklusive ett utfärdande ID-nummer.

1.6 Ytterligare undermoduler

De undermoduler som beskrivs i det här avsnittet kan finnas eller inte, beroende på produktens konfiguration i sjukvårdsorganisationen. Varje undermodul kan öppnas genom att klicka på ett specifikt menyalternativ på en rullgardinsmeny som visas bredvid patientknappen. De är patientrelaterade, det vill säga att de endast är tillgängliga om en patient redan är utvald.

1.6.1 CDSS-konfigurator

Undermodulen CDSS Configurator kan aktiveras genom konfiguration som en extra del av Control Bar Web. Så här öppnar du undermodulen CDSS-konfigurator:

- Välj relevant patient.



Se användarhandboken för USR SWE Patient Explorer Web för patientvalsproceduren (dokument USR SWE Patient Explorer Web).


Om ytterligare Control Bar-undermoduler är tillgängliga efter patientvalet, visas  ikonen på patientknappen (Figur 21 **A**).



Figur 21

- Klicka på  ikonen.


Ett rullgardinsfönster visas med en lista över ytterligare tillgängliga undermoduler (Figur 22).



Figur 22

- Klicka på "CDSS Configuration" (Figur 22 **A**).

Följande fönster visas med en lista över reglerna som är kopplade till den för närvarande valda patienten (Figur 23).



Figur 23

Se CDSS Configurator-användarmanualen för den fullständiga beskrivningen och instruktionerna för användning av denna undermodul (dokument USR SWE CDSS Web).

1.6.2 Identitet

Undermodulen Identity kan aktiveras genom konfiguration som en extra del av Control Bar Web. Så här öppnar du undermodulen Identity:

- Välj relevant patient.



Se användarhandboken för *USR SWE Patient Explorer Web* för patientvalsproceduren (dokument: *USR SWE Patient Explorer Web*).


Om ytterligare Control Bar-undermoduler är tillgängliga efter patientvalet, visas  ikonen på patientknappen (Figur 24 **A**).



Figur 24

- Klicka på  ikonen.


Ett rullgardinsfönster visas med en lista över ytterligare tillgängliga sektioner (Figur 25).



Figur 25

- Klicka på "Associerade enheter" (Figur 25 **A**).

Följande fönster visas med en lista över enheterna som är associerade med den för närvarande valda patienten (Figur 26).

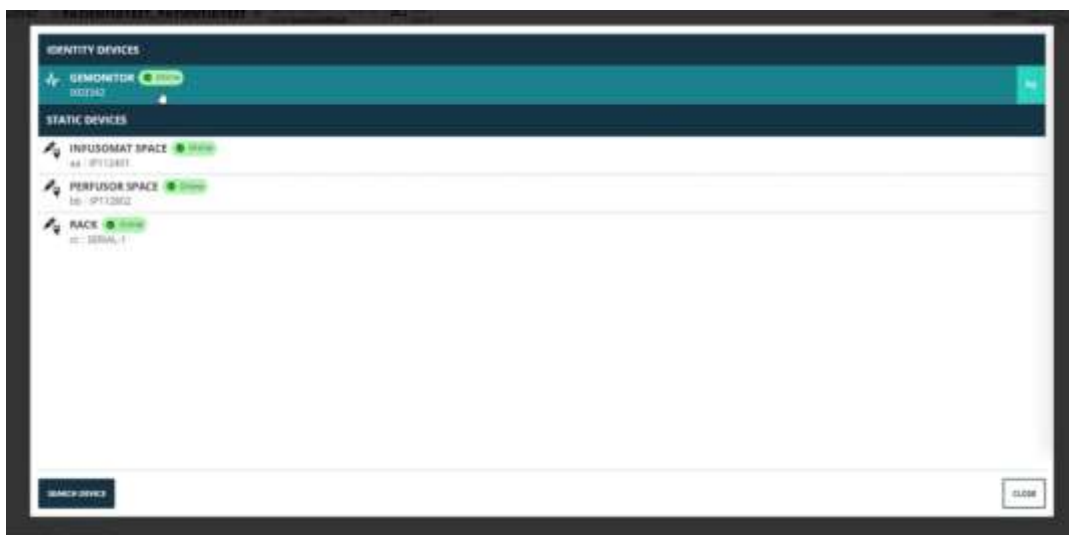

Figur 26

Se Identity-användarmanualen för den fullständiga beskrivningen och instruktionerna för användning av denna undermodul (dokument USR SWE Identity Web).